



By Royal Charter

EC Certificate - Full Quality Assurance System Certificate History

Certificate No: **CE 644261**
Date: **20 April 2017**
Issued To: **Ventlab, LLC
2710 Northridge Dr. NW
Suite A
Grand Rapids
Michigan
49544
USA**

Date	Reference Number	Action
04 December 2016	8429266	First issue, transfer from another notified body.
20 April 2017	8728088	Certificate renewal.



...making excellence a habit™

Page 1 of 1

Validity of this certificate is conditional on the quality system being maintained to the requirements of the Directive as demonstrated through the required surveillance activities of the Notified Body. This approval excludes all products designed and/or manufactured by a third party on behalf of the company named on this certificate, unless specifically agreed with BSI.
This certificate was issued electronically and is bound by the conditions of the contract.

Information and Contact: BSI, Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes MK5 8PP. Tel: +44 345 080 9000.
BSI Assurance UK Limited, registered in England under number 7805321 at 389 Chiswick High Road, London W4 4AL, UK.
A member of BSI Group of Companies.

CE Sertifikatas – Pilnas produkcijos kokybės užtikrinimas

Medicinos priemonių direktyvos 93/42/EEC II priedas, išskyrus 4 skyrių

Nr. **CE 644261**
Išduota: **Ventlab, LLC**
2710 Northridge, Dr. NW
Suite A
Grand Rapids
Mičiganas
49544
JAV

Dėl:

Nesterilių rankinio valdymo gaivinimo maišų, aerozolinių kaukių, deguonies kaukių, deguonies kaniulių, skirtų kvėpavimo priežiūrai kūrimas, gamyba ir galutinė patikra

Atsižvelgiant į mūsų atliktą kokybės užtikrinimo sistemos apžiūrą pagal Tarybos direktyvos 93/42/EEC II priedo, išskyrus 4 skyrių, reikalavimus. Kokybės užtikrinimo sistema atitinka direktyvos keliamus reikalavimus. Norint rinkoje pardavinėti III klasės produktus, reikalingas II priedo 4 skyriaus sertifikatas.


BSI vardu, Notifikuojanti institucija dėl minėtos Direktyvos (Notifikuojančios institucijos Nr. 0086):

/Parašas/

Stewart Brain, Atitikties ir rizikos – medicinos priemonės direktorius

Pirmas leidimas: **2016 m. gruodžio 4 d.**

Galiojimo data: **2022 m. balandžio 2 d.**

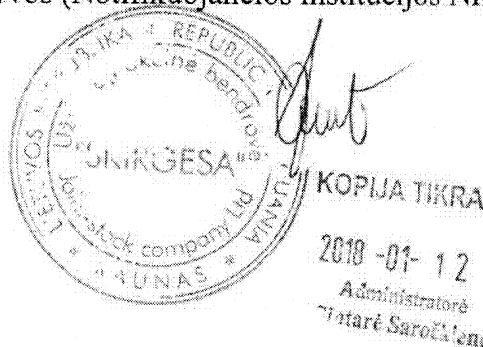

Data: **2017 m. balandžio 20 d.**

Puslapis: 1 iš 1

Šio sertifikato galiojimas yra sąlyginis priklausomai nuo Direktyvos reikalavimų užtikrinimo kokybės sistemoje. Šis pritarimas negalioja visiems produktams šiame sertifikate minėtos įmonės vardu, sukurtiems ir/ar pagamintiems trečiosios šalies, nebent buvo atskirai sutarta su BSI.

Šis sertifikatas yra išleistas elektronine forma ir yra apribotas sutarties sąlygų.

CE Sertifikatas – Pilnas produkcijos kokybės užtikrinimas

Medicinos priemonių direktyvos 93/42/EEC II priedas, išskyrus 4 skyrių

Svarbių subrangovų sąrašas

Pripažintų susijusiais su paslaugų teikimu produktams, sertifikuojamiems:


Sertifikato Nr. **CE 644261**
Data: **2017 m. balandžio 20 d.**

Išleista: **Ventlab, LLC**
2710 Northridge, Dr. NW
Suite A
Grand Rapids
Mičiganas
49544
JAV

Subrangovas	Teikiama(os) paslauga(os)
MT Promedt Consulting GmbH Altenhofstrasse 80 66386 Š. Ingbert Vokietija	ES atstovas
SunMed AP, Ltd Nr. 6-9 Zhufeng Road Qiannan Industrial Park Doumen District, Zhuhai Guangdong Kinija	Gamyba

KOPIJA TIKRA

2018-01-12

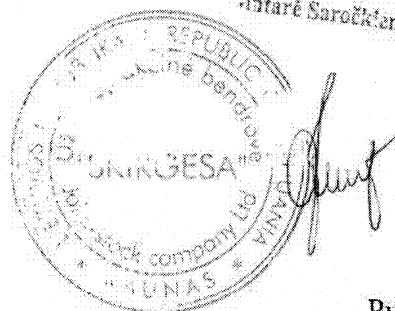Administratorė
Gintarė Saročkaitė

CE sertifikatas - Kokybės užtikrinimo sertifikatų istorija


Sertifikato Nr. CE 644261
Data: 2017 m. balandžio 20 d.

Išleista: Ventlab, LLC
2710 Northridge, Dr. NW
Suite A
Grand Rapids
Mičiganas
49544
JAV

Data	Dokumento numeris	Veiksmas
2016-12-04	8429266	Pirmas leidimas, perėjimas iš kitos notifikuotos institucijos
2017-04-20	8728088	Sertifikato atnaujinimas

KOPIJA TIKRA

2018-01-12

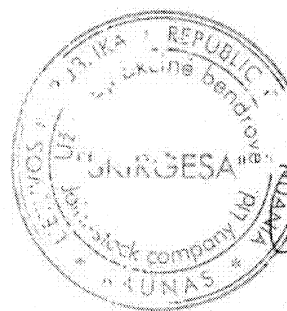Administratorė
Gintarė Saročkienė

Puslapis 1 iš 1



By Royal Charter

EC Certificate - Full Quality Assurance System

Directive 93/42/EEC on Medical Devices, Annex II excluding Section 4

No.

CE 540595

Issued To:

**Teleflex Medical
IDA Business and Technology Park
Dublin Road
Athlone
Co. Westmeath
Ireland**


In respect of:

The design and manufacture of non active digestive tract devices; non active gynecological devices; non active regional anaesthesia devices; non active respiratory devices; non active surgical devices; non active urology devices.

on the basis of our examination of the quality assurance system under the requirements of Council Directive 93/42/EEC, Annex II excluding section 4. The quality assurance system meets the requirements of the directive. For the placing on the market of class III products an Annex II section 4 certificate is required.

For and on behalf of BSI, a Notified Body for the above Directive (Notified Body Number 0086):

Frank Lee, EMEA Compliance & Risk Director

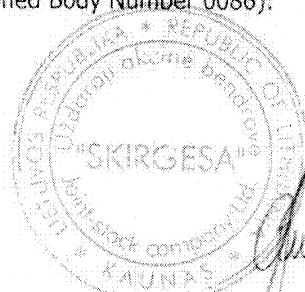

KOPIJA TIKRA

2010-01-05

Administravimo
Gitarė Sarokienė

First Issued: **13 January 2009**

Date: **28 August 2015**

Expiry Date: **07 September 2020**

...making excellence a habit.™

Page 1 of 1

Validity of this certificate is conditional on the quality system being maintained to the requirements of the Directive as demonstrated through the required surveillance activities of the Notified Body. This approval excludes all products designed and/or manufactured by a third party on behalf of the company named on this certificate, unless specifically agreed with BSI.
This certificate was issued electronically and is bound by the conditions of the contract.

Information and Contact: BSI, Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes MK5 8PP. Tel: +44 845 080 9000
BSI Assurance UK Limited, registered in England under number 7805321 at 389 Chiswick High Road, London W4 4AL, UK.
A member of BSI Group of Companies.



By Royal Charter

EC Certificate - Full Quality Assurance System

Directive 93/42/EEC on Medical Devices, Annex II excluding Section 4

List of Significant Subcontractors

Recognised as being involved in services relating to the product covered by:

Certificate No: **CE 540595**
Date: **28 August 2015**
Issued To: **Teleflex Medical**
IDA Business and Technology Park
Dublin Road
Athlone
Co. Westmeath
Ireland

Subcontractor:	Service(s) supplied
Arrow International CR, a.s. Jamska 2359/47 59101 Zdar nad Sazavou Czech Republic	Control of Sterilization Design Manufacture
Arrow International CR, a.s. Prazska 209 50004 Hradec Kralove Czech Republic	Control of Sterilization Design Manufacture
Arrow Medical Ltd Hatton Gardens Industrial Estate Kington HR5 3RB United Kingdom	Crucial Supplier
CeMed GmbH Oberdorf 41 72419 Neufra Germany	Control of Sterilization Manufacture



...making excellence a habit.™



By Royal Charter

EC Certificate - Full Quality Assurance System


Directive 93/42/EEC on Medical Devices, Annex II excluding Section 4

List of Significant Subcontractors

Recognised as being involved in services relating to the product covered by:

Certificate No: **CE 540595**
Date: **28 August 2015**
Issued To: **Teleflex Medical**
IDA Business and Technology Park
Dublin Road
Athlone
Co. Westmeath
Ireland

Subcontractor:	Service(s) supplied
Chelle Medical Limited PO Box 221 Le Rocher Victoria Mahe Seychelles	Crucial Supplier
Forefront (Xiamen) Medical Devices Co., Ltd No 26 & 28 Haijing Dong Lu Haicang Xiamen Export Processing Zone 361026, Xiamen, Fujian China	Crucial Supplier
Forefront Medical Technology Pte Ltd 35 Joo Koon Circle, 6th Floor Singapore 629110 Singapore	Crucial Supplier

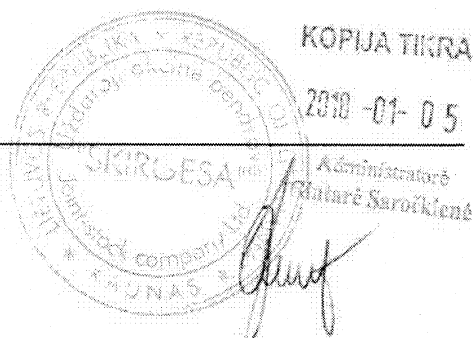

...making excellence a habit.™



By Royal Charter

EC Certificate - Full Quality Assurance System

Directive 93/42/EEC on Medical Devices, Annex II excluding Section 4

List of Significant Subcontractors

Recognised as being involved in services relating to the product covered by:

Certificate No: **CE 540595**
Date: **28 August 2015**
Issued To: **Teleflex Medical**
IDA Business and Technology Park
Dublin Road
Athlone
Co. Westmeath
Ireland

Subcontractor:	Service(s) supplied
M.E.M., Inc. 8 Bishop Lane Madison Connecticut 06443 USA	Crucial Supplier
Parker Medical Systems Division - Merrillville 1201 East 86th Place Merrillville Indiana 46410 USA	Crucial Supplier
Plaxtron Industrial (M) Sdn. Bhd. Plot 28, Kawasan Perusahaan Jelapang II Zon Perdagangan Bebas 30020 Ipoh Perak Malaysia	Crucial Supplier



...making excellence a habit.™



By Royal Charter

EC Certificate - Full Quality Assurance System

Directive 93/42/EEC on Medical Devices, Annex II excluding Section 4

List of Significant Subcontractors

Recognised as being involved in services relating to the product covered by:

Certificate No: **CE 540595**
Date: **28 August 2015**
Issued To: **Teleflex Medical**
IDA Business and Technology Park
Dublin Road
Athlone
Co. Westmeath
Ireland

Subcontractor:	Service(s) supplied
SP Medical A/S Møllevej 1 4653 Karise Denmark	Control of Sterilization Design Manufacture
Süddeutsche Feinmechanik GmbH (SFM) Brückenstrasse 5 D-63607 Wächtersbach Germany	Control of Sterilization Manufacture
Teleflex Medical Sdn. Bhd. Lot PT2577, Jalan Perusahaan 4 34600 Kamunting Perak Malaysia	Control of Sterilization Design Manufacture
Teleflex Medical Asia Pte. Ltd. 6 Battery Road #07-02 049909 Singapore	Control of Sterilization Design Manufacture

KOPIJA TIKRA
2010-01-05
Administrator
Gintarė Saročkaitė
...making excellence a habit™



By Royal Charter

EC Certificate - Full Quality Assurance System

Directive 93/42/EEC on Medical Devices, Annex II excluding Section 4

List of Significant Subcontractors

Recognised as being involved in services relating to the product covered by:

Certificate No: **CE 540595**
Date: **28 August 2015**
Issued To: **Teleflex Medical**
IDA Business and Technology Park
Dublin Road
Athlone
Co. Westmeath
Ireland

Subcontractor:	Service(s) supplied
The Laryngeal Mask Company (Malaysia) Sdn. Bhd. Lot 19 & 1920 Industrial Zone Phase 1 Kulim Hi-Tech Park, Kulim 09000 Malaysia	Crucial Supplier
Tianjin Medis Medical Device Co. Ltd 10A Tianzhi Industrial Centre No 12 Hong Yuan Road Xiqing Economic Development Area 300385 Tianjin City China	Control of Sterilization Manufacture
Willy Rüsç GmbH Willy Rüsç-Strasse 4-10 D-71394 Kernen Germany	Control of Sterilization Design Manufacture



...making excellence a habit.™



By Royal Charter

EC Certificate - Full Quality Assurance System Certificate History

Certificate No: **CE 540595**
Date: **28 August 2015**
Issued To: **Teleflex Medical**
IDA Business and Technology Park
Dublin Road
Athlone
Co. Westmeath
Ireland

Date	Reference Number	Action
13 January 2009	7245725	First issue
17 March 2009	7325719	Company address amended. Extension to scope. Addition of Willy Rüsck, Germany as subcontractor for design and manufacture
25 August 2009	7399879	Addition of 'epidural catheter Epistar and Epistar CSE' to scope. Addition of SFM as significant subcontractor for manufacture. Addition of 'design' to services supplied by Teleflex Medical Malaysia, Arrow International CR, a.s. and Arrow International Inc., Czech Republic
11 November 2009	7455515	Addition of CeMed GmbH for manufacturing to the list of significant subcontractors
20 April 2010	7497906	Laryngeal Mask added to scope. Addition of Tianjin Medis Medical Device Co. Ltd as significant subcontractor for manufacture
08 September 2010	7558508	Scope reworded in accordance with generic device groups. Certificate renewal
23 May 2012	7778467	Correction of significant subcontractor address and addition of new scope activities for subcontractors

...making excellence a habit™

Page 1 of 2

Validity of this certificate is conditional on the quality system being maintained to the requirements of the Directive as demonstrated through the required surveillance activities of the Notified Body. This approval excludes all products designed and/or manufactured by a third party on behalf of the company named on this certificate, unless specifically agreed with BSI.

This certificate was issued electronically and is bound by the conditions of the contract.

Information and Contact: BSI, Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes MK5 8PP. Tel: +44 845 080 9000
BSI Assurance UK Limited, registered in England under number 7805321 at 389 Chiswick High Road, London W4 4AL, UK.
A member of BSI Group of Companies.




By Royal Charter

EC Certificate - Full Quality Assurance System Certificate History

Certificate No: **CE 540595**
Date: **28 August 2015**
Issued To: **Teleflex Medical**
IDA Business and Technology Park
Dublin Road
Athlone
Co. Westmeath
Ireland

Date	Reference Number	Action
04 February 2013	7932588	The addition of a significant subcontractor SP Medical A/S
14 May 2014	8134266	Addition of peripheral angioplasty balloon catheters to product family, covered by scope expression 'non-active surgical devices'. Addition of significant subcontractors Hotspur Technologies, Inc and Teleflex Medical Asia Pte Ltd
09 March 2015	8293488	Addition of 8 crucial suppliers
28 August 2015	8406490	Certificate renewal. Removal of Hotspur Technologies, Inc. from list of significant subcontractors.

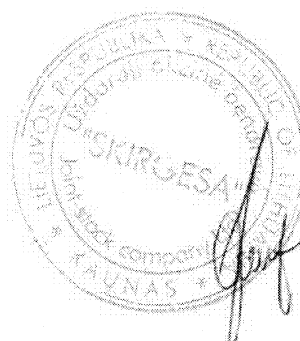

KOPIJA TIKRA

2015-01-05

Administrators
Gintarė Šarolienė

...making excellence a habit.™

Page 2 of 2

Validity of this certificate is conditional on the quality system being maintained to the requirements of the Directive as demonstrated through the required surveillance activities of the Notified Body. This approval excludes all products designed and/or manufactured by a third party on behalf of the company named on this certificate, unless specifically agreed with BSI.
This certificate was issued electronically and is bound by the conditions of the contract.

Information and Contact: BSI, Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes MK5 8PP. Tel: + 44 845 080 9000
BSI Assurance UK Limited, registered in England under number 7805321 at 389 Chiswick High Road, London W4 4AL, UK.
A member of BSI Group of Companies.

CE Sertifikatas - Produkcijos kokybės užtikrinimas

Medicinos priemonių direktyvos 93/42/EEC II priedas, išskyrus 4 skyrių

Nr. **CE 540595**
Išduota: **Teleflex Medical**
IDA Business and Technology Park
Dublin Road
Athone
Co. Westmeath
Airija

Dėl:

Neaktyvių virškinamojo trakto priemonių; neaktyvių ginekologinių priemonių; neaktyvių regioninės anestezijos priemonių; neaktyvių kvėpavimo priemonių; neaktyvių chirurginių priemonių; neaktyvių urologinių priemonių kūrimas ir gamybą

Atsižvelgiant į mūsų atliktą kokybės užtikrinimo sistemos apžiūrą pagal Tarybos direktyvos 93/42/EEC II priedo, išskyrus 4 skyrių, reikalavimus. Kokybės užtikrinimo sistema atitinka direktyvos keliamus reikalavimus. Norint rinkoje pardavinėti III klasės produktus, reikalingas II priedo 4 skyriaus sertifikatas.


BSI vardu, Notifikuojanti institucija dėl minėtos Direktyvos (Notifikuojančios institucijos Nr. 0086):

/Parašas/

Frank Lee, EMEA Atitikties ir rizikos direktorius

Pirmas leidimas: 2009 m. sausio 13 d.

Galiojimo data: 2020 m. rugsėjo 7 d.

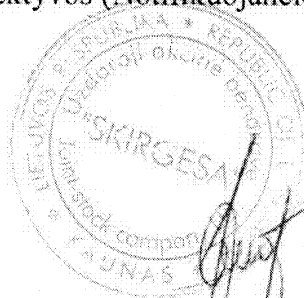

KOPIJA TIKRA

2010-01-05

Administratorius
Gediminas Šarūnas

Data: 2015 m. rugpjūčio 28 d.

Puslapis: 1 iš 1

Šio sertifikato galiojimas yra sąlyginis priklausomai nuo Direktyvos reikalavimų užtikrinimo kokybės sistemoje. Šis pritarimas negalioja visiems produktams šiame sertifikate minėtos įmonės vardu, sukurtiems ir/ar pagamintiems trečiosios šalies, nebent buvo atskirai sutarta su BSI.

Šis sertifikatas yra išleistas elektronine forma ir yra apribotas sutarties sąlygų.

CE Sertifikatas - Produkcijos kokybės užtikrinimas

Medicinos priemonių direktyvos 93/42/EEC II priedas, išskyrus 4 skyrių

Svarbių subrangovų sąrašas


Pripažintų susijusiais su paslaugų teikimu produktams, sertifikuojamiems:

Sertifikato Nr.	Nr. CE 540595
Data:	2015 08 28
Išduota:	Teleflex Medical IDA Business and Technology Park Dublin Road Athone Co. Westmeath Airija

Subrangovas	Teikiama(os) paslauga(os)
Arrow International CR, a.s. Jamska 2359/47 59101 Zdar nad Sazavou Čekijos Respublika	Sterilizacijos kontrolė Dizainas Gamyba
Arrow International CR, a.s. Prazska 209 50004 Hradec Kralove 4 Čekijos Respublika	Sterilizacijos kontrolė Dizainas Gamyba
Arrow Medical Ltd Hatton Gardens Industrial Estate Kington HR5 3RB Jungtinė karalystė	Svarbus tiekėjas
CeMed GmbH Oberdorf 41 72419 Neufra Vokietija	Gamyba Sterilizacijos kontrolė
Teleflex Medixal Sdn. Bhd., Lot PT2577, Jalan Perusahaan 4 34600 Kamunting Perak Malaizija	Sterilizacijos kontrolė Gamyba

KOPIJA TIKRA

2018-01-05

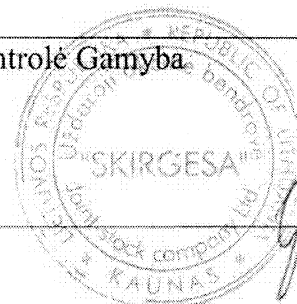Administratorius
Mindaugas Čiulėnas



Medicinos priemonių direktyvos 93/42/EEC II priedas, išskyrus 4 skyrių

Pripažintų susijusiais su paslaugu teikimu produktams, sertifikuojamiems:

Subrangovas	Teiklama(os) paslauga(os)
Chelle Medical Limited	Svarbus tiekējas
PO Box 221	
Le Rocher	
Victoria	
Mahe	
Seišelīai	
Forefront (Xiamen) Medical	Svarbus tiekējas
Devices Co., Ltd	
Nr. 26 & 28 Haijing Dong Lu	
Haicang Xiamen Export	
Processing Zone	
361026, Xiamen, Fujian	
Forefront Medical	Svarbus tiekējas
Technology Pte Ltd	
35 Joo Koon Circle, 6th Floor	
Singapūras 629110	
Singapūras	

KOPIJA TIKRA

2010-01-05

Administratore

Glatare Sarotkine

KOPIJA TRKRA
2010-01-05
Administratore
Gitaré Sarol'k'ne



CE Sertifikatas - Produkcijos kokybės užtikrinimas

Medicinos priemonių direktyvos 93/42/EEC II priedas, išskyrus 4 skyrių

Svarbių subrangovų sąrašas


Pripažintų susijusiais su paslaugų teikimu produktams, sertifikuojamiems:

Sertifikato Nr.	Nr. CE 540595
Data:	2015 08 28
Išduota:	Teleflex Medical
	IDA Business and Technology Park
	Dublin Road
	Athone
	Co. Westmeath
	Airija

Subrangovas	Teikiama(os) paslauga(os)
M.E.M., Inc. 8 Bishop Lane Madison Connecticut 06443 JAV	Svarbus tiekėjas
Parker Medical Systems Division – Merrilville 1201 East 86th Place Merrilleille Indiana 46410 JAV	Svarbus tiekėjas
Plaxtron Industrial (M) Sdn. Bhd. Plot 28, Kawasan Perusahaan Jelapang II Zon Perdagangan Bebas 30020 Ipoh Perak Malaizija	Svarbus tiekėjas

KOPIJA TIKRA

2018-01-05

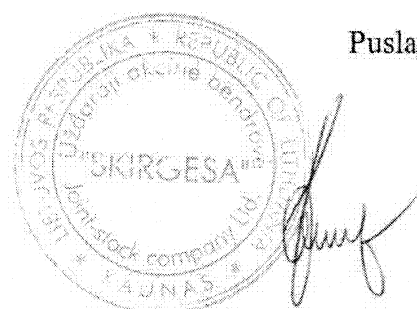Administratorė
Rita R. Sarothienė

CE Sertifikatas - Produkcijos kokybės užtikrinimas

Medicinos priemonių direktyvos 93/42/EEC II priedas, išskyrus 4 skyrių

Svarbių subrangovų sąrašas

Pripažintų susijusiais su paslaugų teikimu produktams, sertifikuojamiems:


Sertifikato Nr.	Nr. CE 540595
Data:	2015 08 28
Išduota:	Teleflex Medical
	IDA Business and Technology Park
	Dublin Road
	Athone
	Co. Westmeath
	Airija

Subrangovas	Teikiama(os) paslauga(os)
SP Medical A/S Mollevvej 1 4653 Karise Vokietija	Sterilizacijos kontrolė Dizainas Gamyba
Süddeutsche Feinmechanik GmbH (SFM) Brückenstrasse 5 D-63607 Wächtersbach Vokietija	Sterilizacijos kontrolė Gamyba
Teleflex Medical Sdn. Bhd. Lot PT2577, Jalan Perusahaan 4 34600 Kamunting Perak Malaizija	Sterilizacijos kontrolė Dizainas Gamyba
Teleflex Medical Asia Pte. Ltd. 6 Battery Road #07-02 049909 Singapūras	Sterilizacijos kontrolė Dizainas Gamyba

KOPIJA TIKRA

2010-01-05

Atstovė
Natalė Surožikienė

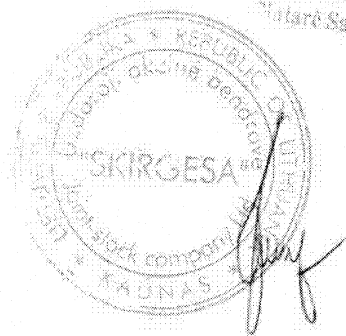

CE Sertifikatas - Produkcijos kokybės užtikrinimas

Medicinos priemonių direktyvos 93/42/EEC II priedas, išskyrus 4 skyrių

Svarbių subrangovų sąrašas

Pripažintų susijusiais su paslaugų teikimu produktams, sertifikuojamiems:

Sertifikato Nr. **Nr. CE 540595**
Data: **2015 08 28**
Išduota: **Teleflex Medical**
IDA Business and Technology Park
Dublin Road
Athone
Co. Westmeath
Airija


Subrangovas	Teikiama(os) paslauga(os)
The Laryngeal Mask Company (Malaizija) Sdn. Bhd. Lot 19 & 1920 Industrial Zone Phase 1 Kulim Hi-Tech Park, Kulim 09000 Malaizija	Svarbus tiekėjas
Tianjin Medis Medical Device Co.Ltd No 12 Hong Yuan Road Xiqing Economic Development Area 300385 Tianjin miestas Kinija	Sterilizacijos kontrolė Gamyba
Willy Rüsch GmbH Willy Rüsch-Strasse 4-10 D-71394 Kernen Vokietija	Sterilizacijos kontrolė Dizainas Gamyba

KOPIJA TIKRA

2010-01-05

Administratorė
Gintarė Saročkienė

Puslapis 5 iš 5

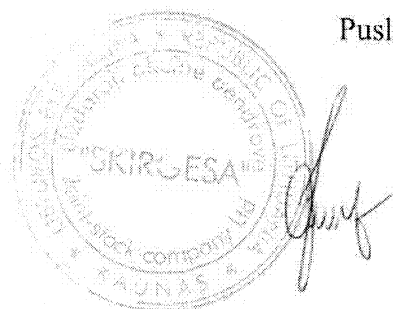

Kokybės užtikrinimo sertifikatų istorija


Sertifikato Nr. **Nr. CE 540595**
Data: **2015 08 28**
Išleista: **Teleflex Medical**
IDA Business and Technology Park
Dublin Road
Athone
Co. Westmeath
Airija

Data	Dokumento numeris	Veiksmai
2009 01 13	7245725	Pirmas leidimas
2009 03 17	7325719	Pataisytas įmonės adresas. Išplėsta sertifikato apimtis. Pridėtas dizaino ir gamybos subrangovas Willy Rüsch, Vokietija.
2009 08 25	7399879	Pridėtas „epidūrinis kateteris Epistar ir Epistar CSE“. Pridėtas svarbus gamybos subrangovas SFM. Pridėtos „dizaino“ paslaugos prie Teleflex Medical, Malaizija, Arrow International, CR, a.s. ir Arrow International, Inc., Čekijos respublika.
2009 11 11	7455515	Pridėtas svarbus gamybos subrangovas CeMed GmbH.
2010 04 20	7497906	Pridėta „laringalinė kaukė“. Pridėtas svarbus gamybos subrangovas Tianjin Medis Medical Device Co. Ltd.
2010 09 08	7558508	Pervadinta sertifikato apimtys priemonių grupė. Sertifikato atnaujinimas
2012 03 23	7778467	Pataisytas svarbaus subrangovo adresas ir pridėtos naujos subrangovų veiklos

KOPIJA TIKRA

2310 -01- 05

Administrative

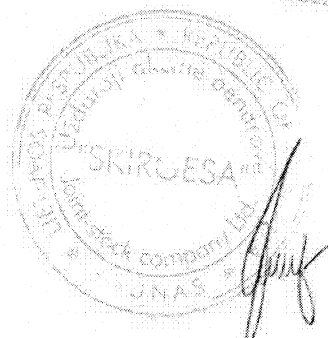

Kokybės užtikrinimo sertifikatų istorija

Sertifikato Nr. Nr. CE 540595
Data: 2015 08 28
Išleista: Teleflex Medical
 IDA Business and Technology Park
 Dublin Road
 Athone
 Co. Westmeath
 Airija


Data	Dokumento numeris	Veiksmas
2013 02 04	7932588	Pridėtas svarbus subrangovas SP Medical A/S
2014 05 14	8134266	Prie produktų linijos pridėti periferiniai angioplastiniai balioniniai kateteriai, kurie priklauso „neaktyvių chirurginių priemonių“ grupei. Pridėtas svarbus subrangovas Hotspur Technologies, Inc ir Teleflex Medical Asia Pte Ltd
2015 03 09	8293488	Pridėti 8 svarbūs tiekėjai
2015 08 28	8406490	Sertifikato atnaujinimas. Hotspur Technologies, Inc. pašalinimas iš svarbių subrangovų sąrašo


KOPIJA TIKRA

2019-01-05

Administratorė
Gintarė Sarožkienė

Puslapis 2 iš 2

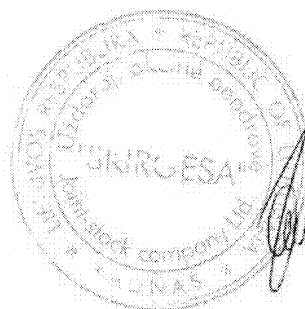



Product Service

EC Certificate

Full Quality Assurance System

Directive 93/42/EEC on Medical Devices (MDD), Annex II excluding (4)
(Devices in Class IIa, IIb or III)

No. G1 15 05 38814 057

Manufacturer:

Well Lead Medical Co., Ltd.

C-4 Jinhu Industrial Estate, Hualong
511434 Panyu, Guangzhou
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

EC-Representative:

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)

Eiffestraße 80
20537 Hamburg
GERMANY

Product Category(ies):

Tracheostomy Tubes, Urethral Catheters,
All Silicone Foley Catheters,
Foley Catheters with Temperature Sensor,
Tracheostomy Tubes with Inner Cannula,
Prefilled Syringes with Lubricating Jelly,
Foley Catheter Kits, Tracheostomy Tube Kits,
Gastrostomy Tubes

The Certification Body of TÜV SÜD Product Service GmbH declares that the aforementioned manufacturer has implemented a quality assurance system for design, manufacture and final inspection of the respective devices / device categories in accordance with MDD Annex II. This quality assurance system conforms to the requirements of this Directive and is subject to periodical surveillance. For marketing of class III devices an additional Annex II (4) certificate is mandatory. See also notes overleaf.

Report No.:

SH15080EXT01

Valid from:

2015-09-07

Valid until:

2020-09-06



Hans-Heiner Junker


Date, 2015-06-15

KOPIJA TIKRA
2018-01-15
Administratorė
Intarė Sarofkienė



TÜV SÜD Product Service GmbH is Notified Body with identification no. 0123

Page 1 of 2



Product Service

EC Certificate**Full Quality Assurance System**

Directive 93/42/EEC on Medical Devices (MDD), Annex II excluding (4)
(Devices in Class IIa, IIb or III)

No. G1 15 05 38814 057

Facility(ies):


Well Lead Medical Co., Ltd.
C-4 Jinhui Industrial Estate, Hualong, 511434
Panyu, Guangzhou, PEOPLE'S REPUBLIC OF
CHINA

Well Lead Medical Co., Ltd.
No 47 Guomao Avenue South, 511434 Panyu,
Guangzhou, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

KOPIJA TIKRA

2018-01-15

Administratore
Mitarë Surorë

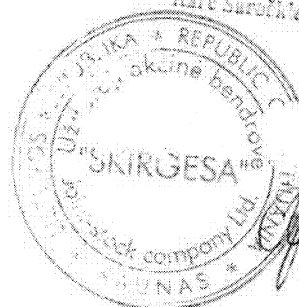

CE SERTIFIKATAS

Pilna kokybės užtikrinimo sistema

Medicinos prietaisų direktyva 93/42/EEB (MDD), Priedas II išskyrus (4)
(IIa, IIb ar III klasės prietaisai)

Nr. G1 15 05 38814 057

Gamintojas:

Well Lead Medical Co., Ltd.

C-4 Jinhu Industrial Estate, Hualong

511434 Panyu, Guangzhou

KINIJOS LIAUDIES RESPUBLIKA

EB atstovas

Shanghai International Holding

Corp. GmbH (Europa)

Eiffestraße 80

20537 Hamburgas

VOKIETIJA

Produkto kategorija(os):

**Tracheostominiai vamzdeliai, ureteriniai kateteriai, visi
silikoniniai Foley kateteriai, Foley kateteriai su temperatūros
davikliu, tracheostominiai vamzdeliai su vidine kaniule, švirkštai
su lubrikantiniu užpildu, Foley kateterių rinkiniai,
tracheostominių vamzdelių rinkiniai, gastrostominiai vamzdeliai**

Sertifikavimo įstaiga TÜV SÜD Product Service GmbH patvirtina, kad paminėtasis gamintojas įdiegė kokybės užtikrinimo sistemą atitinkamų prietaisų/prietaisų kategorijų gamybai ir galutiniam patikrinimui pagal medicinos prietaisų direktyvos 93/42/EEB II Priedą. Ši kokybės užtikrinimo sistema atitinka šios direktyvos sąlygas ir turi būti periodiškai peržiūrima. III klasės produktams yra privalomas papildomas II (4) priedo sertifikatas. Taip pat žr. kitame lape.

Protokolo Nr.

SH15080EXT01

Galioja nuo:

2015-09-07

Galioja iki:

2020-09-06

Data, 2015-06-15

/parašas/

Hans-Heiner Junker

TÜV SÜD Product Service GmbH yra notifikuota įstaiga, identifikacijos Nr. 0123.

Puslapis 1 iš 2

KOPIJA TIKRA

2018-01-15

Administratorė
Intarė Saročkaitė



CE SERTIFIKATAS

Pilna kokybės užtikrinimo sistema

Medicinos prietaisų direktyva 93/42/EEB (MDD), Priedas II išskyrus (4)
(IIa, IIb ar III klasės prietaisai)

Nr. G1 15 05 38814 057

Gamykla (-os):

Well Lead Medical Co., Ltd.

C-4 Jinhu Industrial Estate, Hualong, 511434

Panyu, Guangzhou, KINIJOS LIAUDIES RESPUBLIKA

Well Lead Medical Co., Ltd.

Nr. 47 Guomao Avenue South, 511434 Panyu,


Guangzhou, KINIJOS LIAUDIES RESPUBLIKA

KOPIJA TIKRA

2018-01-15

Administratore
Hafaré Surok'ene





Product Service

EC Certificate

Production Quality Assurance System

Directive 93/42/EEC on Medical Devices (MDD), Annex V
(Devices in Class IIa, IIb or III)

No. G2 15 08 38814 060

Manufacturer:

Well Lead Medical Co., Ltd.

C-4 Jinhu Industrial Estate, Hualong
511434 Panyu, Guangzhou
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA



EC-Representative:

**Shanghai International Holding
Corp. GmbH (Europe)**

Eiffestraße 80
20537 Hamburg
GERMANY

Product Category(ies):

For detailed information see attachment

The Certification Body of TÜV SÜD Product Service GmbH declares that the aforementioned manufacturer has implemented a quality assurance system for manufacture and final inspection of the respective devices / device categories in accordance with MDD Annex V. This quality assurance system conforms to the requirements of this Directive and is subject to periodical surveillance. For marketing of class IIb and III devices an additional Annex III certificate is mandatory. See also notes overleaf.

Report No.:

SH1508017

Valid from:

2015-08-24


Valid until:

2020-08-23

H.-H. Junker

Hans-Heiner Junker

Date, 2015-11-26




KOPIJA TIKRA

2018-01-15

Administratore

Intertek Sarofa, Inc.

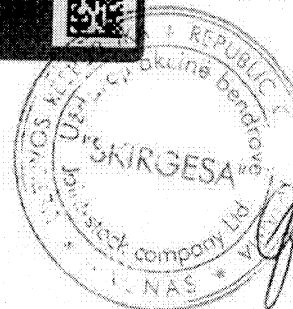

TÜV SÜD Product Service GmbH is Notified Body with identification no. 0123

Page 1 of 3



Production Quality Assurance System


No. G2 15 08 38814 060

Well Lead Medical Co., Ltd.

Well Lead Medical Co., Ltd.

No 47 Guomao Avenue South, 511434 Panyu,
Guangzhou, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Administratore
Giulio Saraceni

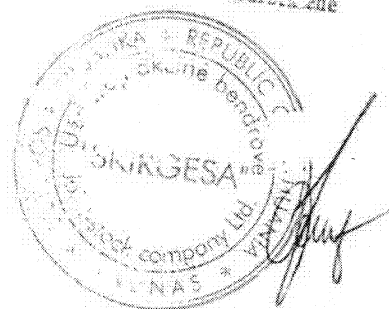

Supplement 001 dated 2015-11-26



Urethral Catheters and Tracheal Tubes, Nelaton Catheters, Connecting Tubes with Yankauer Handle, Intubating Stylets, Laryngeal Mask Devices, Tracheobronchial Tubes, Reinforced Endotracheal Tubes, Nebulizers, Oxygen Masks, Non-Rebreath Masks, Tracheostomy Masks, Aerosol Masks, Multi-vent Masks, Endotracheal Tube Introducers, Nasal Oxygen Cannulas, Stylets, Disposable Air Cushion Face Masks, Endotracheal Tube Kits, HMEF(Heat and Moisture Exchanger Filters), Manual Resuscitators, Drainage Systems, Oxygen Catheters, Silicone Tubes, Endobronchial Blocker Tubes, Extraction Bags(Operation Use), Ureteral Stent Sets, Silicone Drainage Systems, Endotracheal Tubes with Evacuation Lumen, Suction Catheters, Feeding Tubes, Stomach Tubes, Silicone Stomach Tubes, Disposable Self-Catheterization Systems, Capnography CO₂ Sampling Masks, O₂+CO₂ Sampling Cannulas, Non-invasive Positive Pressure Ventilation Masks, Suction Tubes of Oral Care, Bile T-Tubes, Fecal Management Systems, Self Hydrophilic Catheters, Ureteral Access Sheaths, Ureteral Dilation Balloon Catheters, Extracorporeal Circulation Conduct of Blood Purification Apparatus, Urodynamic Catheters, Rectal Pressure Catheters, Anesthetic Breathing Circuits, Dilation Sets, Suction-Evacuation Access Sheaths, Bladder Puncture Fistula. Guide Wire

H. H. L.


Hans-Heiner Junker

Page 3 of 3

KOPIJA TIKRA

2018-01-15

Administratore

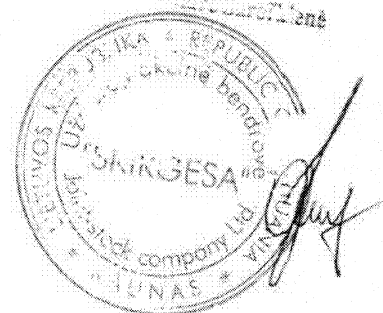

CE SERTIFIKATAS

Pilna kokybės užtikrinimo sistema

Medicinos prietaisų direktyva 93/42/EEB (MDD), Priedas V
(IIa, IIb ar III klasės prietaisai)

Nr. G1 15 08 38814 060

Gamintojas:

Well Lead Medical Co., Ltd.
C-4 Jinhu Industrial Estate, Hualong
511434 Panyu, Guangzhou
KINIJOS LIAUDIES RESPUBLIKA

EB atstovas

Shanghai International Holding
Corp. GmbH (Europa)
Eiffestraße 80
20537 Hamburgas
VOKIETIJA

Produkto kategorija(os): **Detalesnė informacija priede**

Sertifikavimo įstaiga TÜV SÜD Product Service GmbH patvirtina, kad paminėtasis gamintojas įdiegė kokybės užtikrinimo sistemą atitinkamų prietaisų/prietaisų kategorijų gamybai ir galutiniam patikrinimui pagal medicinos prietaisų direktyvos 93/42/EEB V Priedą. Ši kokybės užtikrinimo sistema atitinka šios direktyvos sąlygas ir turi būti periodiškai peržiūrima. IIb ir III klasės produktams galioja papildomas III priedas. Taip pat žr. kitame lape.

Protokolo Nr.

SH1508017

Galioja nuo:

2015-08-24

Galioja iki:

2020-08-23

Data, 2015-11-26


/parašas/
Hans-Heiner Junker

TÜV SÜD Product Service GmbH yra notifikuota įstaiga, identifikacijos Nr. 0123.

KOPIJA TIKRA

2018-01-15

Administratore
Gintarė Saročaitė

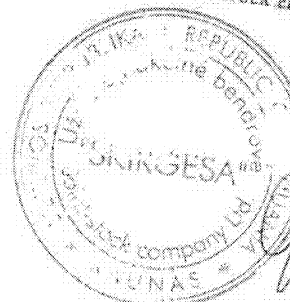

Pilna kokybės užtikrinimo sistema

Nr. G2 15 08 38814 060

Well Lead Medical Co., Ltd.

C-4 Jinhu Industrial Estate, Hualong, 511434


Panyu, Guangzhou, KINIJOS LIAUDIES RESPUBLIKA

Well Lead Medical Co., Ltd.

Nr. 47 Guomao Avenue South, 511434 Panyu,

Guangzhou, KINIJOS LIAUDIES RESPUBLIKA

Administrators
Clarence S. Sullivan

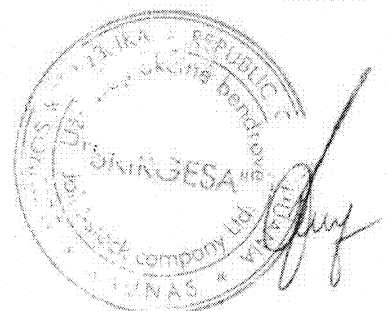

Priedas prie sertifikato Nr. G2 15 08 38814 060

Papildytas 001 data 2015 – 11- 26

Galioja šiems produktams:


Ureteriniams katereriams ir trachėjos vamzdeliams, nelatono kateteriams, sujungimo vamzdeliams su jankauerio rankena, intubaciniams stiletams, laringinėms kaukėms, tracheobronchiniams vamzdeliams, armuotiems endotrachėjiniams vamzdeliams, purkštuvams, deguonies kaukėms, neinvazinėms kaukėms, tracheostominėms kaukėms, aerzolinėms kaukėms, daugiaventiliacinėms kaukėms, endotrachėjinių vamzdelių stiletams, nosinėms deguonies kaukėms, stiletams, vienkartinėms veidinėms anestezinėms kaukėms, endotrachėjinių vamzdelių rinkiniams, šilumos ir drėgmės filtrams, ambu maišams, drenavimo sistemoms, deguonies kateteriams, silikoniniams vamzdeliams, endobronchiniams vamzdeliams, maišeliai ekstrakcijai, ureterinių stentų rinkiniams, silikoninėms drenavimo sistemoms, endotrachėjiniams vamzdeliams su kanalu, atsiurbimo kateteriams, maitinimo vamzdeliams, skrandžio zondams, silikoniniams skrandžio zondams, vienkartinėms kateterizavimo sistemoms, kanografinėms CO2 matavimo kaukėms, O2 + CO2 matavimo kaniulėms, Ne invazinėms teigiamo slėgio kaukėms, atsiurbimo vamzdeliams burnos priežiūrai, tulžies T-vamzdeliams, fekalinėms sistemoms, hidrofiliniams kateteriams, ureteriniams apvalkalams, ureteriniams dilataciniams balioniniams kateteriams, ekstrakorporinės cirkuliacijos kraujo valymo aparatui, urodinaminiams kateteriams, rektaliniams slėgio kateteriams, anesteziniams kvėpavimo kontūrams, dilatacijos rinkiniams, evakuacijos siurbimo prieigos movos, pūslės punkcijos fistulėms, vieliniams pravedėjams,

Miunchenas, CRT2, 2015-11-26

/parašas/

Hans-Heiner Junker

Puslapis 3 iš 3

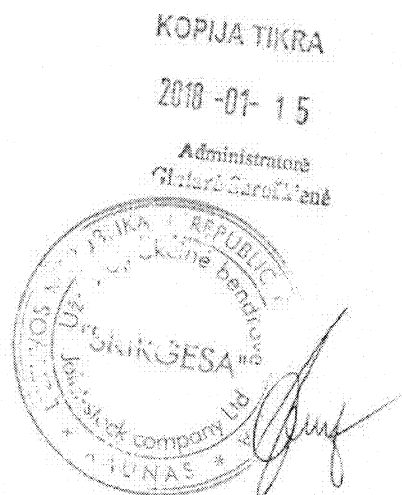

EC Certificate
Directive 93/42/EEC Annex V
Production Quality Assurance
Medical Devices



Registration No.: DD 60117020 0001

Report No.: 26300232 005

Manufacturer: ZARYS International Group
Spolka z ograniczona
odpowiedzialnoscia
spolka komandytowa
ul. Pod Borem 18
41-808 Zabrze
Poland

Products: (see attachments for products and sites included)

Replaces EC Certificate, Registration No.: DD 60100191 0001

Expiry Date: 2019-06-08


The Notified Body hereby declares that the requirements of Annex V of the directive 93/42/EEC have been met for the listed products. The above named manufacturer has established and applies a quality assurance system, which is subject to periodic surveillance, defined by Annex V, section 4 of the aforementioned directive. For placing on the market of class IIb and class III devices covered by this certificate an EC type-examination certificate according to Annex III is required.

Effective Date: 2017-03-07

Date: 2017-03-07

Notified Body

Dr. K. Kluge



TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg

TÜV Rheinland LGA Products GmbH is a Notified Body according to Directive 93/42/EEC concerning medical devices with the identification number 0197.

TÜV Rheinland
LGA Products GmbH
Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

Doc. 1/5, Rev. 0

**Attachment to
Certificate**

Registration No.: DD 60117020 0001
Report No.: 26300232 005

Manufacturer: ZARYS International Group
Spolka z ograniczona
odpowiedzialnoscia
spolka komandytowa
ul. Pod Borem 18
41-808 Zabrze
Poland

Products included:

- Sterile and non-sterile cutting gauze
- Non-sterile dressing gauze
- Sterile and non-sterile gauze swabs
(with or without X-ray thread)
- Sterile and non-sterile gauze lap sponges
(with X-ray thread/ with X-ray chip)
- Sterile and non-sterile gauze balls
(with or without X-ray thread)
- Sterile and non-sterile gauze rolls
(with or without X-ray thread)
- Sterile and non-sterile non-woven swabs
(with or without X-ray thread)
- Sterile paraffin gauze dressings
- Sterile three-way stopcocks
- Sterile transfusion sets for single use
- Sterile infusion sets for single use
- Sterile extension tubes for infusion pump
- Sterile endotracheal tubes
- Sterile tracheostomy tubes
- Sterile breathing circuits
- Sterile catheter mounts

Date: 2017-03-07

Notified Body

Dr. K. Kluge
Dr. K. Kluge




KOPIJA TIKRA

2018-01-09

Administratore





TÜV Rheinland
LGA Products GmbH
Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

Doc. 2/5, Rev. 0

**Attachment to
Certificate**

Registration No.: DD 60117020 0001
Report No.: 26300232 005

Manufacturer: ZARYS International Group
Spolka z ograniczona
odpowiedzialnoscia
spolka komandytowa
ul. Pod Borem 18
41-808 Zabrze
Poland

Products included:

- Sterile laryngeal masks
- Sterile oxygen masks
- Sterile Multi-Vent masks
- Sterile non-rebreath masks
- Sterile nebulizer masks
- Sterile nasal oxygen cannulas
- Sterile nebulizer sets
- Sterile oxygen tubing
- Sterile suction catheters
- Sterile feeding tubes
- Sterile urology catheters
- Sterile surgical suction sets
- Sterile surgical suction cannulas
- Sterile syringes for single use
- Sterile hypodermic needles
- Sterile insulin pen needles
- Sterile IV cannulas
- Sterile needle free valves
- Sterile insulin syringes

KOPIJA TIKRA

2018-01-09

Aktualizacja
Główny Sąd okręgowy

Date: 2017-03-07

Notified Body

Dr. K. Kluge
Dr. K. Kluge





TÜV Rheinland
LGA Products GmbH
Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

Doc. 3/5, Rev. 0

**Attachment to
Certificate**

Registration No.: DD 60117020 0001
Report No.: 26300232 005

Manufacturer: ZARYS International Group
Spolka z ograniczona
odpowiedzialnoscia
spolka komandytowa
ul. Pod Borem 18
41-808 Zabrze
Poland

Products included:

For the following medical devices the scope covers only
the aspects of manufacture concerned with securing and
maintaining sterile conditions:


- Adhesive cannula fixation dressings
- Adhesive wound dressings
- Eye pads
- Incise films
- Transparent film dressings
- Foam dressings
- Absorbent wound dressings
- Surgical gowns
- Surgical drapes
- Fluid collection pouches
- Nelaton catheters

KOPIJA TYTKRA
2010-01-09
Administrators
Główny Europejski

Date: 2017-03-07

Notified Body

Dr. K. Kluge
Dr. K. Kluge



[Signature]

TÜV Rheinland
LGA Products GmbH
Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

Doc. 4/5, Rev. 0

**Attachment to
Certificate**

Registration No.: DD 60117020 0001
Report No.: 26300232 005

Manufacturer: ZARYS International Group
Spolka z ograniczona
odpowiedzialnoscia
spolka komandytowa
ul. Pod Borem 18
41-808 Zabrze
Poland

Products included:

For the following medical devices the scope covers only
the aspects of manufacture concerned with securing and
maintaining sterile conditions:

- Vaginal speculums
- Cervical brushes
- Urine bags
- Tongue depressors
- Guedel airways
- Intubation stylets
- Tracheal tube holders
- Suction tubes
- Withdrawal cannulas
- Alginate dressings
- Cannula stoppers

KOPIJA TYTUŁA


2018-01-09

Zatwierdzenie
T. K. Kluge

Date: 2017-03-07

Notified Body

Dr. K. Kluge
Dr. K. Kluge





TÜV Rheinland
LGA Products GmbH
Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

Doc. 5/5, Rev. 0

**Attachment to
Certificate**

Registration No.: DD 60117020 0001
Report No.: 26300232 005

Manufacturer: ZARYS International Group
Spolka z ograniczona
odpowiedzialnoscia
spolka komandytowa
ul. Pod Borem 18
41-808 Zabrze
Poland

Sites included:


ZARYS International Group
Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia
spolka komandytowa
ul. Gustawa Eiffel'a 15
44-109 Gliwice
Poland

Activity:
Production

Date: 2017-03-07

Notified Body


Dr. K. Kluge
Dr. K. Kluge



KOPIJA TYTUŁA

2017-01-09

Attestacja
Główny Inspektorat

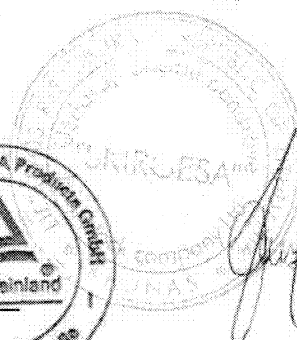

CE sertifikatas
93/42/EEC Direktyva V Priedas
Gamybos kokybės užtikrinimas
Medicinos prietaisai

Registracijos Nr.: DD 60117020 0001

Ataskaitos Nr.: 26300232 005

Gamintojas: Zarys International Group
Spolka z ograniczona
odpowiedzialnoscia
spolka komandytowa
ul. Pod Borem 18
41-808 Zabrze
Lenkija

Produktai: (Žr. Priedus dėl produktų ir įtrauktų vietų)
Pakeičia CE sertifikatą Nr. DD 60100191 0001

Galioja iki: 2019-06-08

Notifikuota įstaiga patvirtina minėtos įmonės įdiegtą ir taikomą kokybės valdymo sistemą. Direktyvos 93/42/EEB V Priedo reikalavimai buvo įvykdyti. Minėtas gamintojas yra įdiegęs ir taiko kokybės užtikrinimo sistemą, kuri yra periodiškai tikrinama, pagal minėtos direktyvos V Priedo 4 skyrių. IIb ir III klasės prietaisų, minimų šiame sertifikate, perkėlimui į rinką būtinas EB tipo patikros sertifikatas pagal III Priedą.

Galioja nuo: 2017-03-07


Notifikuota įstaiga

/parašas/ /antspaudas/
Dr. K.Kluge

Data: 2017-03-07

TÜV Rheinland LGA Products GmbH – Tillystrasse 2 – 90431 Nürnberg

TÜV Rheinland LGA Products GmbH yra Notifikuota įstaiga pagal Direktyvą 93/42/EEB dėl medicinos prietaisų, kurios identifikavimo numeris: 0197.

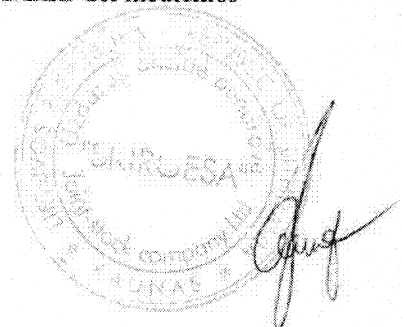

221-2

TÜV Rheinland
LGA Products GmbH
Tillystrasse 2, 90431 Nürnberg

Priedas prie sertifikato

Registracijos Nr.:

DD60117020 0001

Ataskaitos Nr.:

26300232 005

Gamintojas:

Zarys International Group
Spolka z ograniczona
odpowiedzialnoscia
spolka komandytowa
ul. Pod Borem 18
41-808 Zabrze
Lenkija

Itraukti Produktai:

- Sterili ir nesterili kerpama marlė
 - Nesterilūs marliniai tvarsčiai
 - Sterilus/nesterilus marlinis tvarstis
- (su/be rentgenokonstrastine linija)
- Sterilūs ir nesterilūs marlės rutuliai
- (su/be rentgenokonstrastine linija)
- Sterilūs ir nesterilūs marlės ritiniai
- (su/be rentgenokonstrastine linija)
- Sterilūs ir nesterilūs neaustinės medžiagos tvarsčiai
- (su/be rentgenokonstrastine linija)
- Sterilūs parafininiai tvarsčiai
 - Sterilūs trijų krypčių kraneliai
 - Sterilios vienkartinės transfuzinės sistemos
 - Sterilios vienkartinės infuzinės sistemos
 - Sterilios prailginimo linijos infuzinėms pompoms
 - Sterilūs endotrachėjiniai vamzdeliai
 - Sterilūs tracheostominiai vamzdeliai
 - Sterilio kvėpavimo grandinės
 - Sterilūs prailgintojai prie intub. Vamzdelio

Data: 2017-03-07


Notifikuota įstaiga

/parašas/ /antspaudas/
Dr. K.Kluge

KOPIJA TIKRA

2010-01-09

Administracijoje
Gyotari, Suroi k'zind

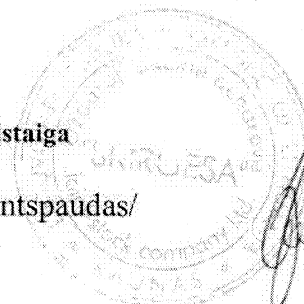

TÜV Rheinland
LGA Products GmbH
Tillystrasse 2, 90431 Nürnberg

Priedas prie sertifikato
Registracijos Nr.:

DD60117020 0001

Ataskaitos Nr.:

26300232 005

Gamintojas:

Zarys International Group
Spolka z ograniczona
odpowiedzialnoscia
spolka komandytowa
ul. Pod Borem 18
41-808 Zabrze
Lenkija

Itraukti Produktai:

- Sterilios laringinės kaukės
- Sterilios deguonies kaukės
- Sterili kaukė su rezervuaru
- sterili aerosolinė kaukė
- Sterlios nosies deguonies kaniulės
- Sterilūs aerosoliniai rinkiniai
- Sterilūs deguonies vamzdeliai
- Sterilūs atsiurbimo kateteriai
- Sterilūs chirurginiai atsiurbimo rinkiniai
- Sterilios chirurginės atsiurbimo kaniulės
- Sterilūs vienkartiniai švirkštai
- Sterilios hipoderminės adatos
- Sterilios insulininių penų adatos
- Sterilios intraveninės kaniulės
- Sterilūs beadatiniai vožtuvai
- Sterilūs insulininiai švirkštai

Data: 2017-03-07


Notifikuota įstaiga

/parašas/ /antspaudas/
Dr. K.Kluge

KOPIJA TIKRA

2010-01-09

Administracija
Taryba Saeckel'ne

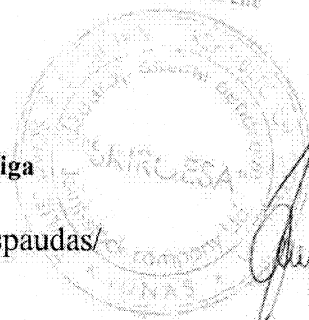

**TÜV Rheinland
LGA Products GmbH
Tillystrasse 2, 90431 Nürnberg**

**Priedas prie sertifikato
Registracijos Nr.:**

DD60117020 0001

Ataskaitos Nr.:

26300232 005

Gamintojas:

**Zarys International Group
Spolka z ograniczona
odpowiedzialnoscia
spolka komandytowa
ul. Pod Borem 18
41-808 Zabrze
Lenkija**

Įtraukti Produktai:

Žemiau nurodytiems medicinos prietaisams reikalavimai taikomi tik gamybos aspektams, susijusiems su sterilių sąlygų kūrimų bei išlaikymu:

- Lipnus kaniulių fiksatoriai
- Lipnūs žaizdų tvarsčiai
- Akių tamponėliai
- Pjūvio juosta
- Permatomi juostiniai tvarsčiai
- Putų tvarsčiai
- Absorbuojantys žaizdų tvarsčiai
- Chirurginiai chalatai
- Chirurginiai dangalai
- Skysčių rinkimo talpos
- Nelaton kateteriai

Data: 2017-03-07


Notifikuota įstaiga

**/parašas/ /antspaudas/
Dr. K.Kluge**

KOPIJA TIKRA

2018-01-09

Administracija
Gintarė Sarackienė

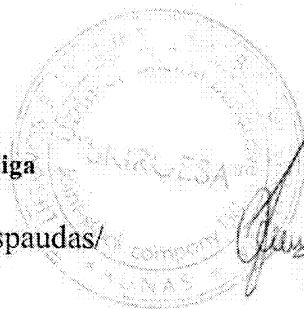

**TÜV Rheinland
LGA Products GmbH
Tillystrasse 2, 90431 Nürnberg**

Priedas prie sertifikato
Registracijos Nr.: DD60117020 0001

Ataskaitos Nr.: 26300232 005

Gamintojas: Zarys International Group
Spolka z ograniczona
odpowiedzialnoscia
spolka komandytowa
ul. Pod Borem 18
41-808 Zabrze
Lenkija

Itraukti Produktai:

Žemiau nurodytiems medicinos prietaisams reikalavimai taikomi tik gamybos aspektams, susijusiems su sterilių sąlygų kūrinių bei išlaikymu:

- Vaginalinės spekulės
- Gimdos kaklelio šepetėliai
- Šlapimo maišeliai
- Liežuvio prispaudėjai
- Orofaringiniai vamzdeliai
- Intubaciniai stiletai
- Tracheostominio vamzdelio laikikliai
- Atsiurbimo vamzdeliai
- Ištraukimo kaniulės
- Alignato tvarsčiai
- Kaniulių kamštukai

Data: 2017-03-07


Notifikuota įstaiga

/parašas/ /antspaudas/
Dr. K.Kluge

KOPIJA TIKRA

2018-01-09

A.Čiulinskaitė
Statistinė Servisė

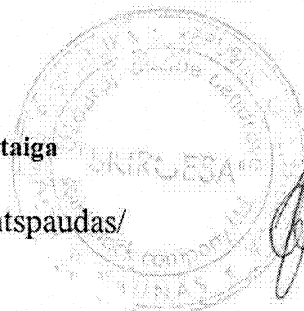

**TÜV Rheinland
LGA Products GmbH
Tillystrasse 2, 90431 Nürnberg**

**Priedas prie sertifikato
Registracijos Nr.:**

DD60117020 0001

Ataskaitos Nr.:

26300232 005

Gamintojas:

**Zarys International Group
Spolka z ograniczona
odpowiedzialnoscia
spolka komandytowa
ul. Pod Borem 18
41-808 Zabrze
Lenkija**

Itrauktos vietos:

**Zarys International Group
Spolka z ograniczona
odpowiedzialnoscia
spolka komandytowa
ul. Gustawa Eiffel'a 15
44-109 Gliwice
Lenkija**

Data: 2017-03-07


Notifikuota įstaiga

/parašas/ /antspaudas/

KOPIJA TIKRA

2010-01-09

Administratore
Gustawa Eiffel'a 15

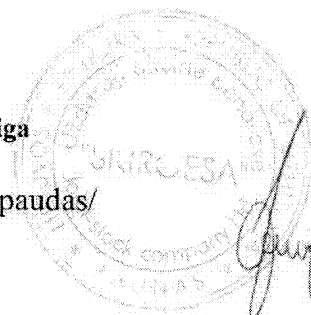

INTERNACIONAL FARMACEUTICA S.A. DE C.V.

Vasaris 05, 2015

Suinteresuotiems asmenims:

Mes, INTERNATIONAL FARMACEUTICA S.A. DE C.V., adresu Carretera #44 Col. Parque San Andres, Coyoacan, Meksika D.F. C.P. 04040, Meksika; pareiškiame, jog mūsų kompanija gamina žemiau išvardintus siūlus:

- Atramat PGA (Poliglikolio rūgštis);
- Atramat PGLA90 poliglaktinas 910 poli (glikolido-laktidas);
- Atramat PGLA90 RAPID poliglaktinas 910 poli (glikolidas, l-laktidas) greitos rezorbcijos;
- Atramat PGA RAPID (Poliglikolio rūgštis) greitos rezorbcijos;
- Atramat PDX (Polydioksanonas);
- Atramat PGC25 poli (Glikolido-ko-Epsilon-kaprolaktonas);
- Atramat Polypropylenas monofilamentas;
- Atramat Polyesteris;
- Atramat Nylon;
- Atramat Šilkas.

Visi mūsų siūlai yra gaminami 45cm, 70cm, 75cm ir 90cm ilgių.

Mūsų kompanija taiko kokybės sistemą, kuri atitinka standartus direktyvos 93/42/EEC taikomą medicinos prietaisams, Annex II; EN ISO 9001:2008 ir EN ISO 13485:2012.

KOPIJA TIKRA

2018-04-09

Administratorė
Gintarė Saročkienė



Nailonas

1 p.d.

- Monofilamentinis, sintetinis, nesirezorbuojantis, juodos, mėlynos spalvos arba nedažytas siūlas.
- Sudaryti iš poliamido 6.0 ir 6.6. ilguju grandinių.
- Audinio reaktyvumas yra minimalus.
- Nailonas yra nesirezorbuojanti medžiaga, kuri laikui bėgant sutraukiama jungiamuoju audiniu.
- Žinoma, kad dėl cheminių jungčių prasiveržimo hidrolizės metu, siūlo masė apytiksliai sumažėja 10%.
- **Spalvos kodas:** žalia
- Paprastai naudojami neurologijoje, oftalmologinėje ir plastinėje chirurgijoje.

BENDROS SAVYBĖS:

Šio siūlo stiprumas ir pailginimas užtikrina audinio kraštų suartinimą. Be to, siūlas lengvai prasiskverbia per audinį tuo užtikrindamas greitą žaizdos užgijimą. Šios fizinės savybės kartu su minimaliu audinio reaktyvumu sudaro gerą siūlą, kuris naudojamas specialiojoje chirurgijoje. Nailono siūlams naudojamos aukštos kokybės tiksliai nusmailintos adatos.

SAVYBĖS:

- Sintetinis (iš geriausios žaliavos).
- Neturi įpakavimo atminties.
- Monofilamentinis.
- Hermetiškai įpakuotas. Strilus.
- Lygus, elastingas, vientisas siūlas.
- Tiksliai nusmailintos adatos, skirtos specialiajai chirurgijai (oftalmologijai, plastinei chirurgijai).
- Juodos spalvos.
- Mėlynos spalvos.

PRIVALUMAI:

- Mažas audinio reaktyvumas.
- Neturi įpakavimo atminties.
- Vienodai prasiskverbia per audinio atramą tokiu būdu išvengiant audinio tempimo.
- Garantuojamas produkto sterilumas.
- Siūlo storis atitinka adatos storį. Atraumatinė adata, nelinksta ir nelūžta.
- Gerai prasiskverbia per audinį užtikrindamas gerus plastinius rezultatus.
- Gerai matomas.
- Rišant siūlas nesimezga į mazgus.

INDIKACIJOS:

NAILONAS (mėlynas, juodas)

Plastinėje chirurgijoje, ginekologijoje, ortopedijoje ir bendrojoje chirurgijoje.



KOPIJA TIKRA

2018-04-09

Administratore
Gintarė Saročkienė

NAILONAS (juodas)

Oftalmologijoje, neurologijoje, periferinėje mikro kraujagyslių chirurgijoje.

NAILONAS (nedažytas)

Plastinėje ir rekonstrukcinėje chirurgijoje.

Pastaba: chirurgai šiuos siūlus gali naudoti visur, kur reikia stiprių, nesirezorbuojančių, viengubų siūlų, tačiau turi žinoti šių siūlų savybes, privalumus ir trūkumus.

ŽALIAVA:

Poliamidas 6.0 arba 6.6.

SPALVA:

Juoda, mėlyna Nr. 2 FDC.

STERILIZAVIMO METODAS:

Gama radiacija arba etileno oksidas.

PADENGIMAS:

Nėra.

GALIOJIMO DATA:

5 metai nuo pagaminimo datos.

KOPIJA TIKRA

2018-04-09

Administratorė
Gintarė Saročkienė



Atvirkstinio pjovimo adata		3/8 apskritimo							
Tipas	Adata	Ilgis	USP 6-0 EP 0,7	USP 5-0 EP 1	USP 4-0 EP 1,5	USP 3-0 EP 2	USP 2-0 EP 3	USP 0 EP 3,5	USP 1 EP 4
CE12 12 mm		45 cm / juodas	CE1246-N	CE1245-N	CE1244-N				KOPIJA
CE16 16 mm		45 cm / juodas	CE1646-N	CE1645-N	CE1644-N				2018-04
		75 cm / juodas	CE1646-75N	CE1645-75N	CE1644-75N	CE1643-75N			
CE19 19 mm		45 cm / juodas	CE1945-N	CE1945-N	CE1944-N	CE1943-N	CE1942-N		
		75 cm / juodas	CE1946-75N	CE1945-75N	CE1944-75N	CE1943-75N	CE1942-75N		
		45 cm / juodas			CE2444-N	CE2443-N	CE2442-N	CE2441-N	
CE24 24 mm		75 cm / juodas		1.3 puz	CE2444-75N	CE2443-75N	CE2442-75N	CE2441-75N	
		45 cm / juodas		<u>CE2645-N</u>	CE2644-N	CE2643-N	CE2642-N		
CE26 26 mm		75 cm / juodas				CE2643-75N	CE2642-75N		
		75 cm / juodas				CE3043-75N	CE3042-75N	CE3041-75N	CE3048-75N
CE30 30 mm		90 cm / juodas				CE3043-90N	CE3042-90N		
		75 cm / juodas						CE3741-75N	<u>CE3748-75N</u>
CE37 37 mm		90 cm / juodas							

Atramat

Nailonas

Tiesi pjaunanti

Pjaunanti

Tipas	Adata	Ilgis	USP 4-0 EP 1,5	USP 3-0 EP 2	USP 2-0 EP 3	USP 0 EP 3,5
U60 60 mm		75 cm / juodas	U6044-N	U6043-N	1.3poz U6042-N	U6041-N

Aukštesnės kokybės tiesi pjaunanti adata

Tipas	Adata	Ilgis	USP 3-0 EP 2	USP 2-0 EP 3
PU55 55 mm		100 cm / mėlynas		PU5542-100
PU60 60 mm		75 cm / mėlynas	PU6043	
		75 cm / juodas	PU6043-N	
		100 cm / juodas		PU6042-100N

Patogi pjaunanti adata

3/8 apskritimo

Tipas	Adata	Ilgis	USP 6-0 EP 0,7	USP 5-0 EP 1	USP 4-0 EP 1,5	USP 3-0 EP 2	USP 2-0 EP 3
NE19 19 mm		45 cm / juodas	NE1946-N	NE1945-N	NE1944-N	NE1943-N	NE1942-N

Premium patogi pjaunanti adata

3/8 apskritimo

Tipas	Adata	Ilgis	USP 6-0 EP 0,7	USP 5-0 EP 1	USP 2-0 EP 3
QE16 16 mm		35 cm / juodas	QE1646-35N		
		45 cm / mėlynas		QE1645	
		45 / juodas	QE1646-N		
QE40 40 mm		45 cm / mėlynas			

KOPIJA TIKRA
2018-04-09
Administratorė
Gintarė Surošienė

Premium patogi pjaunanti adata

3/8 apskritimo

Tipas	Adata	Ilgis	USP 2-0 EP 3	USP 1-0 EP 4
QE90 90 mm		50 cm / juodas		
		100 cm / mėlynas	QE9042-100	

LIETUVOS RESPUBLIKA *
UŽSARAIŠKINIS BENDROVĖS
"SRIKUSA"
Retention Tube
40 mm
JOINT STOCK COMPANY
KAUNAS

NYLON MONOFILAMENT POLYAMIDE (BLACK & BLUE)



NEEDLE LENGTH AND DESCRIPTION	GAUGE		LENGTH	PRODUCT CODE (PRD. CODE)
	USP	METRIC		
19mm ▼ 3/8 circle reverse cutting	5/0	1	45cm	NL15019B4
	4/0	1.5	45cm	NL14019B4
	3/0	2	45cm	NL13019B4
	2/0	3	45cm	NL12019B4
	1/0	3.5	45cm	NL11019B4
20mm ▼ 3/8 circle reverse cutting	5/0	1	45cm	NL15020F4
	4/0	1.5	45cm	NL14020F4
	3/0	2	45cm	NL13020F4
	2/0	3	45cm	NL12020F4
	1/0	3.5	45cm	NL11020F4
26mm ▼ 1/2 circle reverse cutting	5/0	1	75cm	NL25025F4
	4/0	1.5	75cm	NL24025F4
	3/0	2	75cm	NL23025F4
	2/0	3	75cm	NL22025F4
	1/0	3.5	75cm	NL21025F4
26mm ▼ 3/8 circle reverse cutting <i>Pjaukanti ad.</i>	4/0	1.5	75cm	NL24026F4
	3/0	2	75cm	NL23026F4
	2/0	3	75cm	NL22026F4
	1/0	3.5	75cm	NL21026F4
	4/0	1.5	75cm	NL24030F4
30mm ▼ 3/8 circle reverse cutting <i>Pjaukanti ad.</i>	3/0	2	75cm	NL23030F4
	2/0	3	75cm	NL22030F4
	1/0	3.5	75cm	NL21030F4
37mm ▼ 3/8 circle reverse cutting <i>Pjaukanti ad.</i>	4/0	1.5	75cm	NL24037F4
	3/0	2	75cm	NL23037F4
	2/0	3	75cm	NL22037F4
	1/0	3.5	75cm	NL21037F4
	0	3.5	75cm	NL21037F4

KOPIJA TIKRA

2018-04-09

Administrators

Gintare Sarockiene



PGLA90 (Poliglaktinas)

2p.d.

- Sintetinis, besirezorbuojantis, violetinės spalvos arba nedažytas polifilamentinis siūlas.
- Pagamintas iš poliglikolio rūgšties (glikolido) ir L-laktido (poliglikolido ir L-laktido) kopolimerų.
- Audinio reaktyvumas mikroskopinėje formoje yra minimalus.
- Absorbcija įvyksta per hidrolizę; pilna absorbcija – 56 - 70 parų.
- Procentinis stiprumo išlaikymas yra 75 % po 2 savaitių ir 50 % po 3 savaitių.
- Spalvos kodas: violetinė
- Naudojami audinių suartinimo ir oftalmologinėms procedūroms.

Atramat PGLA90 susideda iš:

Poliglikolio rūgštis90 %
L-laktidas10 %
Padengimas.....<1 %
(Poli (glikolidas L-laktidas) ir kalcio stearatas).

SAVYBĖS:

- Stiprus. Sterilus.
- Supintas, geros rišimo savybės, rišant nesimezga į mazgus.
- Absorbcija vyksta per hidrolizę.
- Cilindriškai padengtas.
- Gerai prasiskverbia.
- Dydžiai atitinka U.S.P./E.P. direktyvas.
- Hermetiškai sandarus įpakavimas.
- Antibakterinis

PRIVALUMAI:

- Siūlo storis atitinka adatos storį. Adatos nelinksta ir nelūžta.
- Nuspėjamas absorbcijos koeficientas ir minimalus audinio reaktyvumas.
- Vienodai pralenda pro audinį.
- Plastmasinis mazgelio sujungimas suteikia puikią apsaugą.
- Kuo mažesnis skersmuo, tuo stipresnis.
- Garantuojamas produkto sterilumas.

Mikroskopiniu pagrindu, ATRAMAT PGLA90 turi minimalų audinio reaktyvumą. Be to, ATRAMAT PGLA90 pasižymi nuspėjamu absorbcijos koeficientu ir stiprumu, atitinkančiu USP standartą. Absorbcija vyksta per hidrolizę.

KOPIJA TIKRA

2019-04-09

Administratorė
Antarė Saročkienė



REKOMENDACIJOS:

Rekomenduojama padaryti kvadratinį mazgą su 2 arba 3 papildomais lenktais mazgais. Atsižvelgiant į aplinkybes ir chirurgo patirtį, palikite 2-3 mm ilgio mazgų galus.

INDIKACIJOS:

Naudojami visose chirurginėse operacijose, minkštiems audiniams ir/arba ligatūroms. Naudojami: bendrojoje chirurgijoje, gastroenterologijoje, ginekologijoje, urologijoje, plastinėje chirurgijoje, ortopedijoje ir oftalmologijoje.

Būkite atsargūs, kai šiuos siūlus naudosite pagyvenusiems, dėl prastos mitybos nusilpusiems ar silpnos imuninės sistemos pacientams, nes tokiems pacientams žaizdos lėtai gyja.

KONTRAINDIKACIJOS:

Kadangi tai yra besirezorbuojantis siūlas, jo nereikėtų naudoti, kai audinio atramos reikia neribotam laiko tarpui.

Pastaba: vartotojas, žinantis visas šių siūlų savybes, privalumus ir trūkumus ir atsižvelgęs į chirurgines sąlygas, gali naudoti šiuos siūlus.

ŽALIAVA:

Poliglikolio rūgštis ir L-laktidas.

SPALVA:

Violetinė Nr. 2 D&C, smėlio spalvos ir nedažyta.

PADENGIMAS

Poli (glikolidas L-laktidas) ir kalcio stearatas.

GALIOJIMO Laikas:

5 metai nuo pagaminimo datos.

KOPIJA TIKRA

2019-04-09

Administratorė
Intarė Saročkienė





Premium Spatula
Espatulada Premium

1/4 circle - círculo

Type Tipo	Needle Aguja	Length Longitud	Thread Gauge - Calibre de la Hebra		
			USP 6-0 EP 0.7	USP 5-0 EP 1	USP 4-0 EP 1.5
EA8 8 mm		45 cm	EA8306/2	EA8305/2	EA8304/2

Braided Multifilament
Multifilamento Trenzado



Premium spatula adeta



Premium Spatula
Espatulada Premium

3/8 circle - círculo


Type Tipo	Needle Aguja	Length Longitud	Thread Gauge - Calibre de la Hebra	
			USP 8-0 EP 0.4	USP 7-0 EP 0.5
EE6 6.4 mm		30 cm 45 cm	EE63080/2-30 2.1poz	EE6307/2 2.2poz

2 adatos

Without Needle - Sin Aguja

Type Tipo	Needle Aguja	Length Longitud	Thread Gauge - Calibre de la Hebra				
			USP 3-0 EP 2	USP 2-0 EP 3	USP 0 EP 3.5	USP 1 EP 4	USP 2 EP 5
SS	Without Needle Sin Aguja	3x50 cm	SS03303-50	SS03302-50			
SS	Without Needle Sin Aguja	150 cm	SS00303-150	SS00302-150	SS00301-150	SS00308-150	SS00309-150
SS	Without Needle Sin Aguja	250 cm Reel / Carrete		SS00302-250C	SS00301-250C	SS00308-250C	SS00309-250C

Absorbable
Absorbible

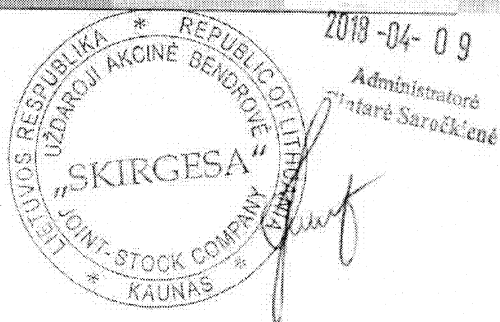

Atramat


duranti ad.

POLIGLAKTINAS 90

Aukštesnės kokybės apvali			1/2 apskritimo						
Tipas	Adata	Ilgis	USP 6-0 EP 0,7	USP 5-0 EP 1	USP 4-0 EP 1,5	USP 3-0 EP 2	USP 2-0 EP 3	USP 0 EP 3,5	USP 1 EP 4
SR13 13 mm		75 cm			SR13304-75				
SR17 17 mm		75 cm	SR17306-75	SR17305-75	2.3 puz SR17304-75	SR17303-75			
SR20 20 mm		75 cm		SR20305-75	SR20304-75	SR20303-75			
SR26 26 mm		75 cm			SR26304-75	SR26303-75	SR26302-75	SR26301-75	
SR30 30 mm		75 cm				SR30303-75	SR30302-75	SR30301-75	SR30308-75
SR36 36 mm		75 cm				SR36303-75	SR36302-75	SR36301-75	

Aukštesnės kokybės Heavy apvali adata			Duranti 1/2 apskritimo				
Tipas	Adata	Ilgis	USP 3-0 EP 2	USP 2-0 EP 3	USP 0 EP 3,5	USP 1 EP 4	USP 2 EP 5
SG36 36 mm		75 cm	SG36303-75	SG36302-75	SG36301-75	SG36308-75	
		90 cm		SG36302-90	SG36301-90	SG36308-90	
SG40 40 mm		75 cm		2.13 puz SG40302-75	SG40301-75	SG40308-75	SG40309-75
		90 cm			SG40301-90	SG40308-90	
SG48 48 mm	8	75 cm				SG48308-75	SG48309-75
		90 cm				SG48308-90	SG48309-90
SG65 65 mm	8	75 cm		SG65302-75			
		90 cm					

KOPIJA TIKRA
2018-04-09
Administratorė
Gintarė Saročkienė
SG65308-90

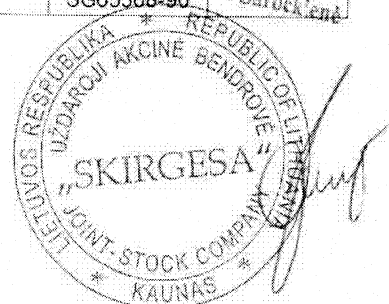

Braided Multifilament
Multifilamento Trenzado



Absorbable
Absorbible




Paprasčiaus tipo		1/2 apskritimo					
Tipas	Adata	Ilgis	USP 6-0 EP 0,7	USP 5-0 EP 1	USP 4-0 EP 1,5	USP 3-0 EP 2	USP 2-0 EP 3
F17 17 mm		75 cm	F17306-75	F17305-75	F17304-75	F17303-75	F17302-75

Paprasčiaus tipo		1/2 apskritimo						
Tipas	Adata	Ilgis	USP 5-0 EP 1	USP 4-0 EP 1,5	USP 3-0 EP 2	USP 2-0 EP 3	USP 0 EP 3,5	USP 1 EP 4
R20 20 mm		75 cm	R20305-75	R20304-75	2,4 poz R20303-75	R20302-75		
R26 26 mm		75 cm	R26305-75	R26304-75	2,5 poz R26303-75	2,8 poz R26302-75	R26301-75	R26308-75
R30 30 mm		75 cm			R30303-75	R20302-75	R30301-75	
R37 37 mm		75 cm				R37302-75		

Heavy apvali adata		1/2 apskritimo					
Tipas	Adata	Ilgis	USP 3-0 EP 2	USP 2-0 EP 3	USP 0 EP 3,5	USP 1 EP 4	USP 2 EP 5
G30 30 mm		75 cm	G30303-75	G30302-75	G30301-75		
		70 cm	G37302	G37302	G37308	G37308	
		75 cm	G37303-75	G37302-75	G37301-75	G37308-75	
G37 37 mm		90 cm		2,11 poz G37301-90	2,16 poz G37301-90	G37308-90	
		75 cm		G40302-75	G40301-75	G40308-75	G40309-75
G40 40 mm		90 cm		G40302-90	G40301-90	G40308-90	G40309-90
		75 cm		G48302-75	G48301-75	G48308-75	G48309-75
G48 48 mm		90 cm		2,14 poz			
					G48301-90	G48308-90	G48309-90
G76 76 mm		75 cm		2,15 poz G7692-75			

KOPIJA TIKRA
2016-04-09
Administratore
Gintarė Saročkienė
SKIRGESA
JOINT-STOCK COMPANY
KAUNAS

Aukštesnės kokybės atvirkštinio pjūvio adata			3/8 apskritimo					
Tipas	Adata	Ilgis	USP 6-0 EP 0,7	USP 5-0 EP 1	USP 4-0 EP 1,5	USP 3-0 EP 2	USP 2-0 EP 3	USP 0 EP 3,5
PE13 13 mm		45 cm / nedažytas	PE13306-45B	PE13305-45B	PE13304-45B			
PE16 16 mm		45 cm / nedažytas		PE16305-45B	PE16304-45B			
PE19 19 mm		45 cm / nedažytas		PE19305-45B	PE19304-45B	PE19303-45B		
		75 cm		PE19305-75	PE19304-75	PE19303-75	PE19302-75	
		75 cm			PE24304-75	PE24303-75	PE24302-75	PE24301-75
PE24 24 mm		75 cm / nedažytas			PE24304-75B	PE24303-75B	PE24302-75B	
PE30 30 mm		75 cm					PE30302-75	PE30301-75

Aukštesnės kokybės Heavy atvirkštinio pjūvio adata			1/2 apskritimo		
Tipas	Adata	Ilgis	USP 0 EP 3,5	USP 1 EP 4	USP 2 EP 5
P40 40 mm		75 cm	P40301-75	P40308-75	P40309-75

Tiesi pjaunanti adata				
Tipas	Adata	Ilgis	USP 4-0 EP 1,5	USP 3-0 EP 2
U60 60 mm		75 cm / nedažytas	U60304-B	U60303-B


Aukštesnės kokybės Spatula, 1/4 apskritimo			
Tipas	Adata	Ilgis	USP 6-0 EP 0,7
EA8 8 mm		45 cm	EA8306

Be adatos							
Tipas	Adata	Ilgis	USP 4-0 EP 1,5	USP 3-0 EP 2	USP 2-0 EP 3	USP 0 EP 3,5	USP 1 EP 4
SS	Be adatos	3x50 cm		SS03303-50	SS03302-50		
SS	Be adatos	150 cm		SS00303-150	SS00302-150	SS00301-150	SS00308-150
SS	Be adatos	250 cm / Ritė			SS00302-250C	SS00301-250C	SS00308-250C
SS	Be adatos	5x70 cm	SS05304	SS0593	SS0592	SS0591	SS0598
SS	Be adatos	6x75 cm		SS06303-75	SS06302-75	SS06301-75	
SS	Be adatos	6x45 cm	SS06304-45	SS06303-45	SS06302-45	SS06301-45	
SS	Be adatos	3x45 cm	SS03304-45	2.6 psz	2.7 psz		
SS	Be adatos	12x45 cm	SS12304-45				
SS	Be adatos	5x45 cm	SS05304-45				
SS	Be adatos	2x75 cm				SS0291-75	SS0298-75

KOPIJA TIKRA

2018-04-09

Administratore
Gintarė Saročkienė

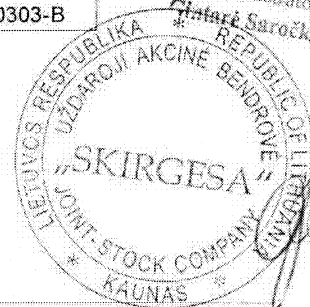

Braided Multifilament
Multifilamento Trenzado



Absorbable
Absorbible



Atramat

POLIGLAKTINAS 90

Braided Multifilament
Multifilamento Trenzado



Absorbable
Absorbible



Atvirkštinio pjūvio adata

Pjaunanti

1/2 apskritimo

Tipas	Adata	Ilgis	USP 3-0 EP 2	USP 2-0 EP 3	USP 0 EP 3,5	USP 1 EP 4	USP 2 EP 5
C22 22 mm		70 cm		C22302-70			
		75 cm	C26303-75	<i>2.3poz</i> C26302-75	C26301-75	C26308-75	
C26 26 mm		90 cm	C26303-90				
C37 37 mm		75 cm		C37302-75	C37301-75	C37308-75	
C40 40 mm		75 cm		<i>2.12poz</i> C40302-75	C40301-75	C40308-75	C40309-75
P48		75 cm			<i>2.17poz</i> P48301-75	<i>2.20poz</i> P48308-75	P48309-75

Aukštesnės kokybės atvirkštinio pjūvio adata

Pjaunanti

1/2 apskritimo

Tipas	Adata	Ilgis	USP 3-0 EP 2	USP 2-0 EP 3	USP 0 EP 3,5	USP 1 EP 4
P36 36 mm		75 cm	P36303-75	<i>2.10poz</i> P36302-75	P36301-75	<i>2.18poz</i> P36308-75
P40 40 mm		75 cm		P40302-75	P40301-75	<i>2.18poz</i> P40308-75
		90 cm		P40302-90	P40301-90	P40308-90


Atvirkštinio pjūvio adata

3/8 apskritimo

Tipas	Adata	Ilgis	USP 5-0 EP 1	USP 4-0 EP 1,5	USP 3-0 EP 2	USP 2-0 EP 3
CE16 16 mm		45 cm / nedažytas	CE16305-45B	CE16304-45B		
		70 cm	CE16305			
CE19 19 mm		45 cm / nedažytas		CE19304-45B	CE19303-45B	
		75 cm	CE19305-75	CE19304-75	CE19303-75	CE19302-75
		75 cm / nedažytas		CE19304-75B	CE19303-75B	
CE24 24 mm		75 cm		CE24304-75	CE24303-75	CE24302-75
		75 cm / nedažytas			CE24303-75B	CE24302-75B
CE30 30 mm		75 cm			CE30303-75	CE30302-75
		75 cm / nedažytas				CE30302-75B

KOPIJA TIKRA

2019-04-09

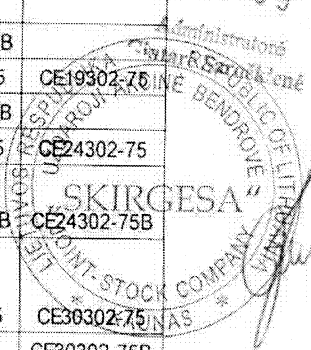

ATRAMAT POLIGLIKOLIO RŪGŠTIS 3p.d.

GREITAI BESIREZORBUOJANTYS CHIRURGINIAI SIŪLAI

Sintetinis, besirezorbuojantis, multifilamentinis pintas siūlas, bespalvis;

Pagamintas iš poliglikolio rūgšties (glikolido polimeras), dengtas polikaprolaktonu kalcio steratu;

Audinių reakcija mikroskopinėje formoje yra minimali;

Absorbcija atsiranda dėl aktyvios hidrolizės, siūlas pilnai absorbuojasi per 42 dienas;

Po pirmos savaitės siūlas išlaiko 50% stiprumo;

Dažniausiai naudojamas greitai gyjantiems audiniams siūti. Adatos nelinksta ir nelūžta.

APRAŠYMAS

Greitos absorbcijos poliglikolio rūgštis padengta polikaprolaktonu ir kalcio steratu sekančiu santykiu:

Poliglikolio rūgštis 99%

Dangalas 1%

Aukščiau paminėti rezultatai adekvačiai išvardinti pagal molekulinę struktūrą ir jos teikiančią naudą:

Charakteristika:	Nauda:
Aukštas siūlo tempimo stiprumas	Atitikamas audinių suartinimas
Pinta struktūra	Lengvai naudojamas
Absorbcija atsiranda dėl hidrolizės	Iš anksto žinomas absorbcijos laikas ir minimali audinių reakcija
Cilindriškai padengtas multifilamentas	Lengvai slysta per audinius
Puikus slydimas per odą	Mazgo plastikinis sujungimas užtikrina puikų saugumą
Dydis U.S.P./E.P. direktyvos	Didesnė tempimo jėga esant mažesniai diametriui

Implantavus į audinį, greitos absorbcijos poliglikolio rūgštis, sorb-FAST, mikroskopiniame lygmenyje sukelia minimalią audinių reakciją. Jis panašus į kitus poliglikolio rūgšties greitos absorbcijos sintetinius siūlus. Tačiau, sorb-FAST iš anksto žinomas absorbcijos laikas ir aukštas siūlo tempimo stiprumas, didesnis nei USP standartas, taip suteikiant gyvybiškai svarbų dirbtinį audinio palaikymą kritiniu žaizdos gyjimo metu. Absorbcija atsiranda dėl progresyvios hidrolizės, kuri trunka 42 dienas, po pirmos savaitės siūlas išlaiko 50% stiprumo.

REKOMENDACIJOS:

Kaip ir su kitomis pintomis siūlų medžiagomis, rekomenduojama risti kvadratinį mazgą su 2 ar 3 papildomais lankiniais mazgais. Mazgo galiukai turėtų būti nuo 2 iki 3 mm ilgio, priklausomai nuo chirurginių aplinkybių ir chirurgo patirties.

INDIKACIJOS:

Siūlai indikuojami naudoti visose chirurginėse procedūrose, kur rekomenduojami besirezorbuojantys siūlai. Tokiose kaip: Plastinė chirurgija, ginekologija, akušerinėse, gastroenterologijoje ir ligavime. Pagrindė, audiniams, kurių trumpas gijimo terminas.

Papildomų atsargumo priemonių reikia imtis jei siūlai naudojami vyresnio amžiaus pacientams, jei pacientas yra menkos mitybos ar serga ligomis, kurios lėtina žaizdų gijimą.

KONTRAINDIKACIJOS:

Besirezorbuojančių siūlų negalima naudoti, kai reikalingas išplėstinis audinių suartinimas ar ilgas gijimo periodas.

Pastaba:atsižvelgiant į išvardintus faktus ir charakteristikas, naudą ir apribojimus apie greitos absorbcijos poliglikolio rūgšties, sorb-FAST siūlą, vartotojas gali pritaikyti jo naudojimą pagal chirurgines aplinkybes ar jo/jos asmeninę patirtį.

Žaliava:

Dengtas homopolimeras ir glikolio rūgštis.

Spalva:

Bespalvis

Sterilizavimo metodas:

Gamma radiacija. Sterilus

Dangalas:

Polikaprolaktonu ir kalcio steratas

GALIOJIMO DATA

5 metai nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotės.


Pagaminta Meksikoje

INTERNATIONAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V.

KOPIJA TIKRA

2018-04-09

Administratorė
Tatara Šaraškinė

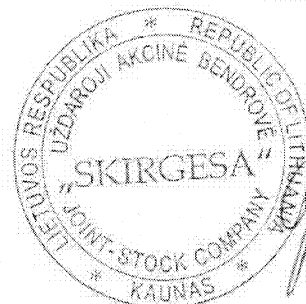

Aukštesnės kokybės atvirkštinio pjovimo adata

Pjaunanti ad.

3/8 apskritimo

Tipas	Adata	Ilgis	USP 6-0 EP 0,7	USP 5-0 EP 1	USP 4-0 EP 1,5	USP 3-0 EP 2	USP 2-0 EP 3
PE11 11 mm		45 cm / nedažytas	PE1186-45B	PE1185-45B			
PE13 13 mm		45 cm / nedažytas	PE1386-45B	PE1385-45B	PE1384-45B		
PE16 16 mm		75 cm / nedažytas			PE1684-75B	PE1683-75B	
PE19 19 mm		75 cm / nedažytas		PE1985-75B	3.1P02 PE1984-75B	PE1983-75B	PE1982-75B
PE24 24 mm		75 cm / nedažytas					PE2482-75B
PE26 26 mm		75 cm / nedažytas				PE2683-75B	PE2682-75B
PE36 36 mm		75 cm / nedažytas				PE3683-75B	PE3682-75B

Aukštesnės kokybės patogi pjaunanti adata

Tipas	Adata	Ilgis	USP 4-0 EP 1,5	USP 3-0 EP 2	USP 2-0 EP 3
U17 17 mm		75 cm / nedažytas	U1784-75B		
U60 60 mm		75 cm / nedažytas		U6083-B	U6082-B

Aukštesnės kokybės patogi pjaunanti adata

1/2 apskritimo

Tipas	Adata	Ilgis	USP 4-0 EP 1,5	USP 3-0 EP 2
Q22 22 mm		45 cm / nedažytas	Q2284-45B	Q2283-45B

Aukštesnės kokybės patogi pjaunanti ada

3/8 apskritimo

Tipas	Adata	Ilgis	USP 4-0 EP 1,5	USP 3-0 EP 2
QE16 16 mm		75 cm / nedažytas	QE1684-75B	QE1683-75B

Be adatos

Tipas	Adata	Ilgis	USP 3-0 EP 2	USP 2-0 EP 3	USP 1-0 EP 3,5	USP 1-0 EP 4
SS	Be adatos	150 cm / nedažytas	SS0083-150B	SS0082-150B	SS0081-150B	SS0088-150B
SS	Be adatos	250 cm / nedažytas	SS0083-250B	SS0082-250B	SS0081-250B	SS0088-250B
SS	Be adatos	3 x 45 cm			SS0381-45	

KOPIJA TIKRA

2019-07-09

Administratorė

Ugnė Sarockienė



Aukštesnės kokybės apvali adata

1/2 apskritimo

Tipas	Adata	Ilgis	USP 5-0 EP 1	USP 4-0 EP 1,5	USP 3-0 EP 2	USP 2-0 EP 3
SR17 17 mm		75 cm / nedažytas	SR1785-75B	SR1784-75B	SR1783-75B	
SR20 20 mm		75 cm / nedažytas		SR2084-75B	SR2083-75B	
SR26 26 mm		75 cm / nedažytas		SR2684-75B	SR2683-75B	SR2682-75B
SR30 30 mm		75 cm / nedažytas				SR3082-75B

Aukštesnės kokybės Heavy apvali adata, 1/2 apskritimo

Tipas	Adata	Ilgis	USP 2-0 EP 3	USP 0 EP 3,5	USP 1 EP 4
SG36 36 mm		90 cm / nedažytas	SG3682-90B		SG3688-90B
SG40 40 mm		90 cm / nedažytas	SG4081-90B	SG4081-90B	SG4088-90B

Atvirkštinio pjovimo adata, 1/2 apskritimo

Tipas	Adata	Ilgis	USP 4-0 EP 1,5
P19 19 mm		45 cm / nedažytas	P1984-45B

2018-04-09

Administratore
Statarė Saročkienė



Atvirkštinio pjovimo adata

Priėjanti ad.

3/8 apskritimo

Tipas	Adata	Ilgis	USP 6-0 EP 0,7	USP 5-0 EP 1	USP 4-0 EP 1,5	USP 3-0 EP 2	USP 2-0 EP 3
CE12 12 mm		45 cm / nedažytas	CE1286-45B	CE1285-45B	CE1284-45B		
CE16 16 mm		45 cm / nedažytas		CE1685-45B	CE1684-75B	CE1683-75B	CE1682-75B
CE19 19 mm		45 cm / nedažytas 75 cm / nedažytas			CE1984-45B	CE1983-45B	
CE24 24 mm		75 cm / nedažytas			CE2484-75B	CE2483-75B	CE2482-75B

3.2 poz

Polidioksanonas

4 p. d.

- Sintetinis, besirezorbuojantis, mėlynos spalvos monofilamentinis siūlas.
- Polidioksanono polimeras.
- Minimalus audinio reaktyvumas.
- Absorbcija vyksta per lėtą hidrolizę; pilna absorbcija – apytiksliai per 170-200 dienų.
- **Spalvos kodas:** mėlyna
- Dažniausiai naudojami audinių suartinimui.
- Po 2sav. išlieka 75% stiprumo, 4 sav. išlieka 70%, po 6 sav. išlieka 50%, stiprumo.

SAVYBĖS

- Stiprus, lankstus, slidus.
- Absorbcija vyksta per hidrolizę.
- Monofilamentinis (vienodo diametro).
- Puikiai pralenda.
- Minkštas. Sterilus
- Molekulinė struktūra, minkšti segmentai.

PRIVALUMAI

- Siūlo storis atitinka adatos storį. Adatos nelinksta ir nelūžta.
- Nuspėjamas absorbcijos koeficientas ir minimalus audinio reaktyvumas.
- Vienodai pralenda pro audinį.
- Inertinis, elastingas.
- Puikiai matomas.
- Geros rišimo savybės, rišant nesimezga į mazgus.

INDIKACIJOS:


Rekomenduojamas bet kuriai chirurginei procedūrai, kur reikia viengubo, sintetinio, besirezorbuojančio siūlo.

MAZGAI: pirmame mazge neužsifiksuoja; rekomenduojama dideliais dydžiais (1, 1-0, 2-0) padaryti chirurginį mazgą ir paprastą mazgą. Tokiu būdu patikrinsite stiprumą. Tada darykite kvadrato formos mazgą.

Mažais dydžiais (3-0, 4-0, 5-0, 6-0): iš pradžių padarykite du kvadratinius mazgus su 2-3 papildomais lenktais mazgais, atsižvelgę į aplinkybes ir chirurgo patirtį, palikite 4-5 mm ilgio mazgų galus.

Elkitės atsargiai, kad nesugadintumėte siūlo su chirurginėmis žnyplėmis, adatomis, išskyrus tuos atvejus, kai norite nugybtį siūlą.

NAUDOJIMAS:

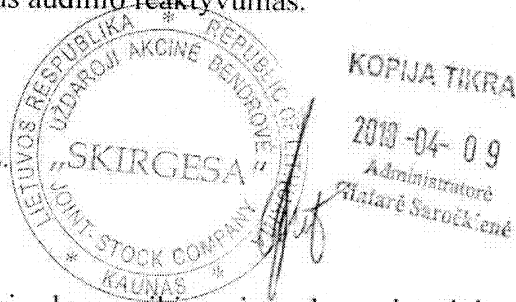

Bendrojoje chirurgijoje, gastroenterologijoje, urologijoje, plastinėje chirurgijoje, ginekologijoje, ir t.t.

Būkite atsargūs, kai šiuos siūlus naudosite pagyvenusiems, dėl prastos mitybos nusilpusiems ar silpnos imuninės sistemos pacientams, nes tokiems pacientams žaizdos lėtai gyja.

KONTRAINDIKACIJOS:

Kadangi tai yra besirezorbuojantis siūlas, jo nereikėtų naudoti, kai audinio atramos reikia neribotam laiko tarpui.

Pastaba: žinant visas aplinkybes apie paciento būklę bei Atramat polidioksanono savybes, privalumus ir trūkumus, šiuos siūlus galima naudoti atsižvelgiant į chirurgines sąlygas ir chirurgų patirtį

ŽALIAVA:

Polidioksanono monomeras

SPALVA:

Mėlyna

STERILIZAVIMO METODAI:

Etileno oksidas

PADENGIMAS:

N/A

GALIOJIMO DATA:

5 metai nuo pagaminimo datos

KOPIJA TIKRA

2010-04-09

Administratore
Jūratė Šaraitienė



Sustiprinta apvali adata

Duriantis ad

1/2 apskritimo

Tipas	Adata	Ilgis	USP 6-0 EP 0.7	USP 5-0 EP 1	USP 4-0 EP 1.5	USP 3-0 EP 2	USP 2-0 EP 3	USP 0 EP 3.5	USP 1 EP 4
SR13 13 mm		45 cm	SR1376-45	SR1375-45					
		70 cm	SR1376						
SR17 17 mm		70 cm		SR1775	SR1774	SR1773			
SR20 20 mm		70 cm			SR2074	SR2073			
SR26 26 mm		70 cm			4.1 puz SR2674	4.3 puz SR2673	4.5 puz SR2672	SR2671	
SR26 26 mm		70 cm				SR2673/2	SR2672/2		
SR30 30 mm		70 cm			SR3074	SR3073	SR3072	SR3071	SR33078

Sustiprinta apvali adata

Duriantis ad

1/2 apskritimo

Tipas	Adata	Ilgis	USP 3-0 EP 2	USP 2-0 EP 3	USP 0 EP 3.5	USP 1 EP 4	USP 2 EP 5
SG36 36 mm		70 cm	SG3673	SG3672	SG3671	SG3678	
		90 cm	4.4 puz	4.7 puz			
SG40 40 mm		70 cm		SG3672-90	SG3671-90	SG3678-90	
		90 cm			SG4071	SG4078	
SG48 48 mm		90 cm			4.10 puz		
					SG4071-90	SG4078-90	
					4.12 puz		
					SG4871-90	SG4878-90	SG4874-90

2018-04-09

Administratorė
Intarė Seročkienė



[Signature]

Extra Heavy apvali adata				
Dursanti				
Tipas	Adata	Ilgis	USP 0 EP 3,5	USP 1 EP 4
X40 40 mm	 150 cm (Loop)	150 cm (kilpa)	X4071-150LOOP	X4078-150LOOP
X48 48 mm	 150 cm (Loop)	150 cm (kilpa)	4.13 poz X4871-150LOOP	4.15 poz X4878-150LOOP
X50 50 mm	 150 cm (Loop)	150 cm (kilpa)	X5071-150LOOP	X5078-150LOOP
X65 65 mm	 150 cm (Loop)	150 cm (kilpa)	X6571-150LOOP	X6578-150LOOP

KOPIJA TIKRA

2010-04-09

Administratorė
Gintarė Sarneckienė



Aukštesnės kokybės atvirkštinio pjovimo adata

Präparat

1/2 apskritimo

Tipas	Adata	Igis	USP 3-0 EP 2	USP 2-0 EP 3	USP 0 EP 3,5	USP 1 EP 4
P26 25 mm		70 cm	4.2poz <u>P2673</u>	4.6poz <u>P2672</u>	P2671	
P36 36 mm		70 cm	P3673	4.8poz <u>P3672</u>	4.9poz <u>P3671</u>	P3678
P40 40 mm		70 cm		P4072	4.11poz P4071	4.14poz <u>P4078</u>

Aukštesnės kokybės atvirkštinio pjovimo adata

3/8 apskritim o

Tipas	Adata	Ilgis	USP 5-0 EP 1	USP 4-0 EP 1,5	USP 3-0 EP 2
PE13 13 mm		45 cm / nedažytas	PE1375-45U	PE1374-45U	
PE16 16 mm		45 cm / nedažytas	PE1675-45U	PE1674-45U	
PE19 19 mm		45 cm / nedažytas	PE1975-45U	PE1974-45U	PE1973-45U
PE24 24 mm		45 cm / nedažytas		PE2474-45U	PE2473-45U

Aukštesnēs kokybēs patogi pjaunanti adal

3/8 apskritimo

Tipas	Adata	Ilgis	USP 6-0 EP 0,7	USP 5-0 EP 1	USP 4-0 EP 1,5	USP 3-0 EP 2
QE13 13 mm		45 cm / nedažytas	QE1376-45U			
QE16 16 mm		45 cm / nedažytas		QE1675-45U	QE1674-45U	KOPU
QE19 19 mm		45 cm / nedažytas			QE1974-45U	2010- QE1973-45U

KOPIJA TIKRA

2018-04-09

Administrators
zare Surock'ene

Aukštesnēs kokybēs tiesi pjaunanti adats

Tipas	Adata	Ilgis	USP 4-00K / USP 3-0 EP 1.5 UNAS	USP 2-0 EP 2	USP 2-0 EP 3
PU60 60 mm		70 cm / nedažytas	PU6074-70U	PU6073-70U	PU6072-70U

Šilkas

7p.d.

- Natūralus, multifilamentinis, pintas, nesirezorbuojantis šilko siūlas.
- Juodos, baltos arba mėlynos spalvos.
- Gaunamas iš Bombyx Mori I naminių šilkverpių rūšies kokono.
- Audinio reaktyvumas yra vidutinis.
- Stiprumas išsilaiko per ilgą laiką, tačiau jis mažėja, kai audinys traukiasi.
- **Spalvos kodas:** mėlyna.
- Dažniausiai naudojami audinių suartinimui arba surišimui, išskyrus urologines procedūras.

SAVYBĖS:

- Geriausios kokybės žaliava.
- Pintas multifilamentinis.
- Nesirezorbuojantis, natūralus.
- Silikoninis padengimas.
- Mėlynos, baltos spalvos (grynas šilkas), su/be silikono.
- Hermetiškai įpakotas. Sterilus.
- Adatos nelinksta ir nelūžta.
- Juodos spalvos (siūlas su silikonu).

PRIVALUMAI:

- Aukštos kokybės šilkas.
- Siūlo pynimui naudojama aukšta technologija užtikrina siūlo kompaktiškumą ir didesnę stiprumą.
- Ilgesnis audinio sutvirtinimo laikas.
- Vienodai prasiskverbiamas pro audinį tokiu būdu išvengiant audinio pjovimo.
- Įvairus pritaikymas.
- Garantuojamas produkto sterilumas.
- Adatos apsauga ir lengvas adatos ištraukimas iš atramos.
- Gerai matomas.

INDIKACIJOS:

Skirtas visoms chirurginėms procedūroms; žinomi šios medžiagos apribojimai.

NAUDOJIMAS:

Bendrojoje chirurgijoje, gastroenterologijoje, oftalmologijoje, ginekologijoje ir akušerijoje..

KONTRAINDIKACIJOS:

Kadangi tai yra nesirezorbuojantis siūlas, jo nerekomenduojama naudoti urologinėse procedūrose, nes aplink šį siūlą gali susidaryti akmenys.



Polipropilenas

8p. d,

- Sintetinis, nesirezorbuojantis, monofilamentinis siūlas. Lankstus, stiprus, neplyštantis.
- Mėlynos spalvos.
- Siūlo skersmuo nustatomas kompiuterio pagalba.
- Audinio reaktyvumas yra minimalus. Nesusidaro granuliacijos.
- Polipropilenas yra labai patvarus; tinkamas naudoti kaip nuolatinė atrama; stiprus.
- **Spalvos kodas:** mėlyna.
- Dažniausiai naudojami specializuotose srityse, kaip pvz., poodinėms ir širdies ir kraujagyslių operacijoms.

BENDROS SAVYBĖS:

Šio siūlo stiprumas ir pailginimas užtikrina audinio kraštų suartinimą. Be to, siūlas lengvai prasiskverbia per audinį tuo užtikrinamas greitą žaizdos užgijimą. Dėl mažo audinio reaktyvumo jis tinka poodinėms operacijoms; dėl pasipriešinimo daugkartiniam lenkimui – jis tinkamas naudoti širdies ir kraujagyslių chirurgijoje.

SAVYBĖS:

- Sintetinis (iš geriausios žaliavos).
- Tinkamas platinėms operacijoms.
- Monofilamentinis.
- Hermetiškai įpakotas. Sterilus.
- Nesirezorbuojantis.
- Pasipriešina daugkartiniam lenkimui.
- Siūlo storis atitinka adatos storį. Adatos nelinksta, nelūžta.
- Aukščiausios kokybės, tiksliai nusmailintos adatos.
- Specialios adatos, skirtos naudoti širdies ir kraujagyslių chirurgijoje.

PRIVALUMAI:

- Mažas audinio reaktyvumas, puikus biosuderinamumas.
- Adekvatus mazgo sujungimas, užtikrinantis mazgo saugumą.
- Vienodai prasiskverbia pro audinį tokiu būdu išvengiant audinio tempimo.
- Garantuojamas produkto sterilumas.
- Neturi įpakavimo atminties.
- Tinka naudoti širdies ir kraujagyslių operacijoms.
- Tiksliai nusmailintų adatų apsauga.
- Gerai prasiskverbia, todėl išvengiama didelių traumų ir užtikrinami geri plastiniai rezultatai.



Siūlo adatos yra tiksliai nusmailintos ir specialiai sukurtos tam, kad būtų pasiekti geri plastiniai rezultatai. Be to, šios adatos yra lanksčios ir kietos.

Siūlo adata yra daug kietesnė nei įprastos adatos, kas užtikrina puikų adatos skvarbumą kalcifikuotose audiniuose ir per ateromatozines plokšteles.

Mes taip pat turime specialias adatas, skirtas širdies ir kraujagyslių operacijoms, kurios lengvai ir vienodai prasiskverbia pro audinį. Visa tai padeda išvengti filtracijos ir tinka naudoti kraujagyslių operacijoms.

INDIKACIJOS:

Širdies ir kraujagyslių chirurgijoje, plastinėje ir rekonstrukcinėje chirurgijoje, poodinėse operacijose, ginekologijoje, ortopedijoje ir bendrojoje chirurgijoje.

Pastaba: vartotojai šiuos siūlus gali naudoti visose procedūrose, kur reikia stiprių, nesirezorbuojančių, viengubų sintetinių siūlų, tačiau turi žinoti šių siūlų savybes, privalumus ir trūkumus.



ŽALIAVA:

Izotaktinio polipropileno homopolimero esteroizomeras

SPALVA:

Mėlyna Nr. 2 FDC

STERILIZAVIMO METODAS:

Etileno oksidas

PADENGIMAS:

Be padengimo

GALIOJIMO DATA:

5 metai nuo pagaminimo datos.

Atramat

SKIRGESA UAB

SKIRGESA UAB

Polipropilenas

Aukštesnės kokybės kardiovaskulinė apvali adata *Duranti ad. 1/2 apskritimo*

Tipas	Adata	Ilgis	USP 5-0 EP 1	USP 4-0 EP 1,5	USP 3-0 EP 1,5	USP 2-0 EP 3
S10 10 mm		75 cm	S1065/2-75			
		75 cm	S1365/2-75			
S13 13 mm		90 cm	S1365/2-75			
S16 16 mm		90 cm	<i>8.1p02</i> S1665/2	S1664/2	S1663/2	S1662/2
S20 20 mm		90 cm	S2065/2	S2064/2	S2063/2	S2062/2
S25 25 mm		90 cm		S2564/2	S2563/2	S2562/2
S30 30 mm		90 cm			S3063/2	S3062/2

Monofilament
Monofilamento


Non Absorbable
No Absorbible



KOPIJA TIKRA

2013-04-09

Administratorius
* JAV REPUBLIKAI *
* UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ *
* SKIRGESA *
* JOINT-STOCK COMPANY *
* KAUNAS *

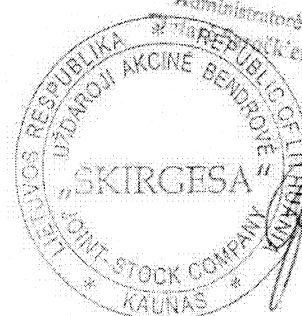

Atramat

MONOFILAMENTAS

MONOFILAMENTAS

Polipropilenas

Monofilament
Monofilamento



Paprasta apvali adata		1/2 apskritimo	
Tipas	Adata	Ilgis	USP 5-0 EP 1
F17 17 mm		75 cm	F1765-75

Paprasta apvali adata		3/8 apskritimo		
Tipas	Adata	Ilgis	USP 6-0 EP 0,7	USP 5-0 EP 1
FE19 12 mm		45 cm	FE1266	FE1265

Paprasta apvali adata			1/2 apskritimo				
Tipas	Adata	Ilgis	USP 4-0 EP 1,5	USP 3-0 EP 1,5	USP 2-0 EP 3	USP 0 EP 3,5	USP 1 EP 4
R20 20 mm		75 cm	R2064-75	R2063-75			
R26 26 mm		75 cm	R2664-75	R2663-75	8.4p2 R2662-75	R2661-75	R2668-75
		90 cm		R2663-90			
R30 30 mm		75 cm		R3063-75	R3062-75	R3061-75	
R37 37 mm		75 cm		R3763-90			

Aukštesnės kokybės kardiovaskuliarinė apvali adata su spaude				1/2 apskritimo
Tipas	Adata	Ilgis	Spaudės dydis	USP 2-0 EP 3
S25 25 mm		90 cm	6x3x1,4 mm	S2562/2-P


Non Absorbable
No Absorbible



KOPIJA TIKRA

2010-04-09

Administracine
Vietinė Surobinė

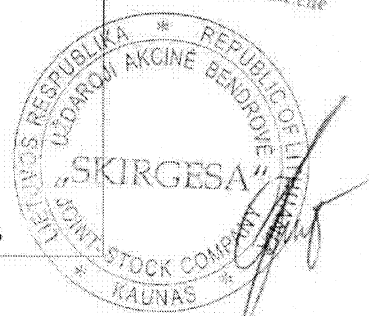

Atramat

STYRENE POLYPROPYLENE

STYRENE POLYPROPYLENE

Polipropilenas

Monofilament
Monofilamento



Atvirkštinio pjūvio o adata

Tipas	Adata	Ilgis	1/2 apskritimo		
			USP 0 EP 3,5	USP 1 EP 4	USP 2 EP 5
C26 26 mm		75 cm	C2661-750		
C37 37 mm		75 cm		C3768-75	C3769-75

Atvirkštinio pjūvio o adata

Pajūvanti ad

3/8 apskritimo

Tipas	Adata	Ilgis	USP 6-0 EP 0,7	USP 5-0 EP 1	USP 4-0 EP 1,5	USP 3-0 EP 2	USP 2-0 EP 3	USP 0 EP 3,5
CE12 12 mm		45 cm	CE1266	CE1265	CE1264			
		75 cm		CE1265-75				
CE16 16 mm		45 cm		CE1665	CE1664			
		75 cm	CE1666-75		CE1664-75			
CE19 19 mm		45 cm		CE1965	CE1964	CE1963		
		75 cm		CE1965-75	CE1964-75	CE1963-75		
CE24 24 mm		45 cm			CE2464	CE2463	CE2462	CE2461
		75 cm			CE2464-75	CE2463-75	CE2462-75	CE2461-75
CE30 30 mm		45 cm			8.2poz CE3063	CE3063	CE3062	
		75 cm			8.3poz CE3063-75	8.5poz CE3062-75	CE3061-75	
CE37 37 mm							CE3762-75	CE3761-75

8.6poz

Aukštesnės kokybės atvirkštinio pjūvio o adata


3/8 apskritimo

Tipas	Adata	Ilgis	USP 7-0 EP 0,5	USP 6-0 EP 0,7	USP 5-0 EP 1	USP 4-0 EP 1,5	USP 3-0 EP 2
PE8 8 mm		45 cm	PE867				
PE13 13 mm		45 cm		PE1366	PE1365		
PE16 16 mm		75 cm			PE1665-75	PE1664-75	
PE19 19 mm		75 cm			PE1965-75	PE1964-75	PE1963-75
PE26 26 mm		75 cm				PE2664-75	PE2663-75

KOPIJA TIKRA

2013-04-09

Administracijos
Gydarė Saročkė

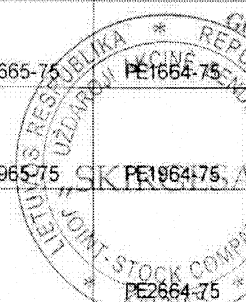

Atramat

SV. PL. 277-0006200001

00000000000000000000

Polipropilenas

Non Absorbable
No Absorbible



Monofilament
Monofilamento



Heavy apvali adata
1/2 apskritimo

Duriant

Tipas	Adata	Ilgis	USP 2-0 EP 3	USP 0 EP 3,5	USP 1 EP 4	USP 2 EP 5
G26 26 mm		75 cm	G2662-75	G2661-75		
G30 30 mm		75 cm	G3062-75	G3061-75		
G37 37 mm		75 cm	G3762-75	<i>8.7poz</i> G3761-75	<i>8.8poz</i> G3768-75	
G40 40 mm		75 cm	G4062-75	G4061-75	G4068-75	G4069-75

KOPIJA TIKRA

2010-04-09

Administratore
Gintarė Saručienė



Kaulų vaškas

Aprašymas 9 poz.

ATRAMAT[®] kaulų vaškas yra sudarytas iš bičių vaško, kuris yra išgaunamas sintezės būdu pilant karštą vandenį ant *Apis mellifera* Linne bičių košių. Kaulų vaškas yra išgaunamas gryninant bičių vašką ir balinant vašką su izopropiliniu palmitatu: tirpiklis turi gerų emulsijos savybių tokiomis proporcijomis: bičių vaškas 80 % ir izopropilinis palmitatas 20 %. ATRAMAT[®] kaulų vaškas yra baltas (nepermatomas).

Veikimas

ATRAMAT[®] kaulų vaškas veikia kaip vietinė kaulų hemostatinė medžiaga, suformuojanti mechaninį barjerą (kaištį). Jis yra neabsorbuojantis ir inertiškas, todėl nesukelia biocheminės reakcijos naudojimo metu.

Kontraindikacijos

ATRAMAT[®] kaulų vaškas neturėtų būti naudojamas, kai reikalinga kaulinė sintezė, kadangi jis gali suveikti kaip dirbtinis barjeras, kuris neutralizuoja kaulinę regeneraciją (osteogenezę).

Produkto kodas: CH-2.5

Sudedamosios medžiagos: bičių vaškas 80 %, izopropilinis palmitatas 20 %

Spalva: N/A

Sterilizacijos metodas: gama spindulių radiacija

Danga: N/A

Pateikimas: dėžutėje su 12, 24 ir 36 vienetais maišeliuose po 2,5 g

Galiojimas: 5 metai po pagaminimo datos



MEMOBAG

Maišelis su atmintimi

Audinių išėmimo maišelis su įvedimo kaniule

Audinių išėmimo maišelis paprastai ir saugiai minimalios invazijos procedūrai, skirtas saugiam mėginių paėmimui, saugus chirurgui ir pacientui.

Iškart po procedūros su susivyniojančiu MemoBag maišeliu per 10 mm trokarą, nitinolio viela su atminties efektu išėmimo maišelio viršutiniame apvade susitraukia atgal į savo pirminę formą ir išlaiko maišėlį pravirą, leisdami trokarą naudoti su kitais instrumentais. Dideli pavyzdžiai gali būti supjaustomi į mažesniu gabaliukus neplyštančio, skaidraus ir nepralaidaus maišelio viduje, nerizikuojant užkrėtimu ar piktybinių ląstelių pasklidimu. Tuomet MemoBag maišelis su atmintimi yra paprastai užveriamas ir pašalinamas.

MEMOBAG				
Ref.	Dydis	Išėmimo maišelis (skersmuo)	Trokaras	Kiekis
332800-000010	200 ml	50 mm	10 mm	5
332801-000020	800 ml 10 pc.	100 mm	10 mm	5
332800-000030	1.200 ml	130 mm	10 mm	5

Nitinolio viela „prisimena“ savo pirminę formą ir prisitaiko prie norimos formos

Išėmimo rinkinys įvedamas per trokarą

MemoBag maišelis su atmintimi yra suvyniotas įvedimo kaniulėje (250mm)

Naudojant stūmiklį maišelis yra atpalaiduojamas ir atsidaro automatiškai

Privalumai:

- pastebimai sumažina užkrėtimo riziką
- lengva įvesti, laikyti ir uždaryti
- nereikia papildomų trokarų
- saugus ir patogus dėl neplyštančio, skaidraus ir nepralaidaus maišelio
- gali būti patikimai atveriamas ir uždaromas keletą kartų
- yra skirtingų dydžių

KOPIJA TIKRA


2013-04-04

Administratorė
Gintarė Saročkienė


KOPIJA TIKRA

2013-04-09

Administratorė
Gintarė Saročkienė

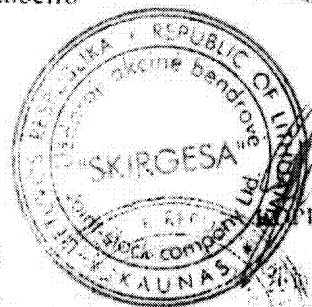

Disposable Linear Cutter

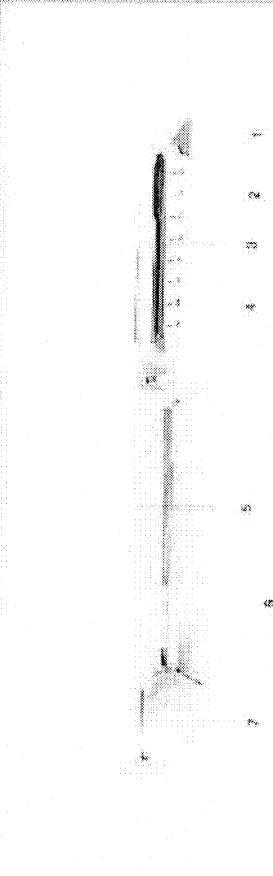1. Cartridge
2. Anvil
3. Protector
4. Cartridge holder
5. Fixed handle
6. Active handle
7. Firing button

Instrument Model	Cartridge Model	Cutting Length (mm)	Suturing Length (mm)	Suturing Thickness (mm)	Staple Height (mm)	Cartridge Color
GH553	GK553	55	57	1.5	3.85	Blue
GH554	GK554	45	57	2	4.5	Green
GH753	GK753	75	77	1.5	3.85	Blue
GH754	GK754	75	77	2	4.5	Green
GH1003	GK1003	100	102	1.5	3.85	Blue
GH1004	GK1004	100	102	2	4.5	Green

11.2
pz.


Features:

- One instrument with blue/green cartridges
- Reloadable instrument to change up to 8 cartridges for single patient.
- Safety mechanism avoids the firing with empty cartridge
- Full range of sizes for different procedure requirements


KOPIJA TIKRA

2018-04-09

Administrators
Gintarė Narockienė

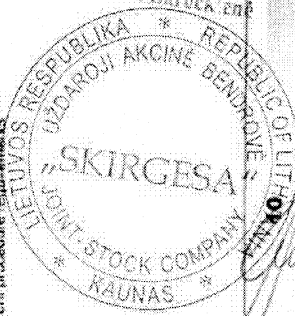

Disposable Linear Cutter (Scapel on the Cartridge)

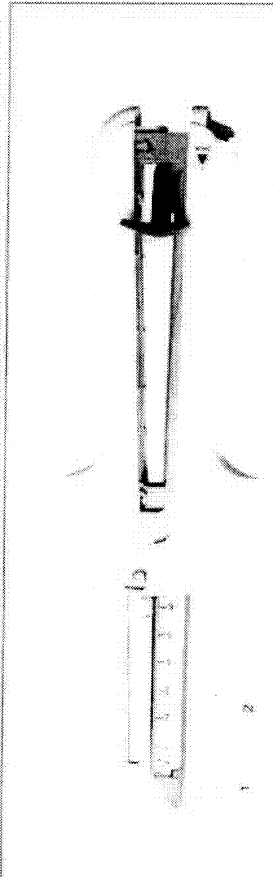1. Cartridge
2. Anvil
3. Firing button
4. Detaching button

Instrument Model	Cartridge Model	Cutting Length (mm)	Suturing Length (mm)	Suturing Thickness (mm)	Staple Height (mm)	Cartridge Color
QAB603	QB603	60	65	1.5	3.85	Blue
QAB604	QB604	60	65	2	4.5	Green
QAB803	QB803	80	85	1.5	3.85	Blue
QAB804	QB804	80	85	2	4.5	Green
QAB1003	QB1003	100	105	1.5	3.85	Blue
QAB1004	QB1004	100	105	2	4.5	Green

Features:

- Unique pushing button, easy for either left or right hand manipulation
- Scapel on the cartridge, better cutting effect.
- Bigger opening, convenient for procedure
- One instrument with blue/green cartridges

Vienkartinis Linijinis siuvimo aparatas

Instrumento modelis	Kasetės modelis	Kirpimo ilgis	Siuvimo ilgis	Siuvimo storis	Kabutės aukštis	Kasetės spalva
---------------------	-----------------	---------------	---------------	----------------	-----------------	----------------

GH553	GK553	55	57	1.5	3.85	Blue
GH554	GK554	55	57	2	4.5	Green
GH753	GK753	75	77	1.5	3.85	Blue
GH754	GK754	75	77	2	4.5	Green
GH1003	GK1003	100	102	1.5	3.85	Blue
GH1004	GK1004	100	102	2	4.5	Green

for. 11.1

for. 11.2

Savybės

- Vienas instrumentas su mėlynom/ žaliom kasetėm
- Pakartotinai užtaisomas instrumentas su galimybe 8 kartus pakeisti kasetę tam pačiam pacientui.
- Saugumo mechanizmas apsaugantis nuo iššovimo, kada kasetė tuščia
- Pilnas dydžių diapozonas skirtingiems procedūrų reikalavimams

2013-04-09

Administratorė
Intarė Saročkienė




ENDOTRACHEAL TUBE

poz: 21.

● Standard Endotracheal Tube


● Uncuffed

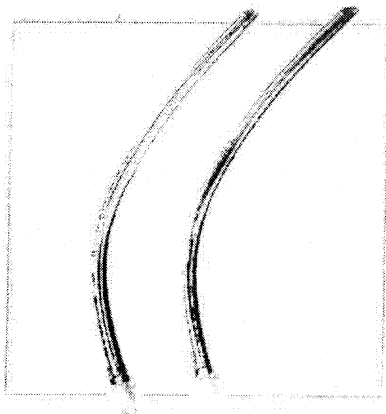


- Feature:**
- Non-toxic, medical grade PVC material.
 - X-ray opaque line.
 - Clear markings for easy observation.
 - Murphy eye design.
 - Standard 15mm ISO connector.

Cat. No.		Cat. No.	
21100020	2.0	21100070	7.0
21100025	2.5	21100075	7.5
21100030	3.0	21100080	8.0
21100035	3.5	21100085	8.5
21100040	4.0	21100090	9.0
21100045	4.5	21100095	9.5
21100050	5.0	21100100	10.0
21100055	5.5	21100105	10.5
21100060	6.0	21100110	11.0
21100065	6.5		

* Available with Magill type (without Murphy eye). For details, please check website: www.welllead.com.cn.

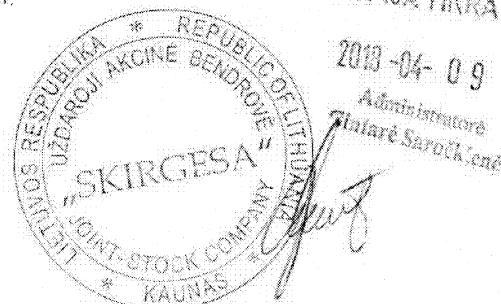

● Cuffed

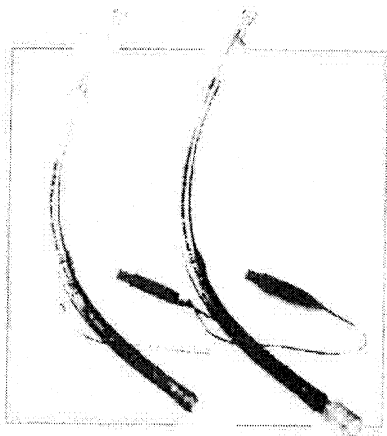

Feature:

- High volume low pressure cuff maintains good sealing.
- Murphy eye design.
- Smooth cuff edges reduce trauma.

Cat. No.		Cat. No.	
21110030	3.0	21120070	7.0
21120035	3.5	21120075	7.5
21120040	4.0	21120080	8.0
21120045	4.5	21120085	8.5
21120050	5.0	21120090	9.0
21120055	5.5	21120095	9.5
21120060	6.0	21120100	10.0
21120065	6.5		

* Available with Magill type (without Murphy eye). For details, please check website: www.welllead.com.cn.

* Available with Low profile cuff. For details, please check the website.

poz 21

Standartiniai endotrachėjiniai vamzdeliai

• Be manžetės

Ypatybės:

Ne toksiški, medicinos klasės PVC.

Rentgeno kontrastinė linija.

Aiškios žymės.

Merflo akis.

Standartiniai ISO 15mm konektoriai.

Kat. kodas	Dydis ID (mm)	Kat. kodas	Dydis ID (mm)
21100030	3.0	21100070	7.0
21100035	3.5	21100075	7.5
21100040	4.0	21100080	8.0
21100045	4.5	21100085	8.5
21100050	5.0	21100090	9.0
21100055	5.5	21100095	9.5
21100060	6.0	21100100	10.0
21100065	6.5		

Standartiniai endotrachėjiniai vamzdeliai


• Su manžete

Ypatybės:

Didelio tūrio žemo slėgio manžetė

Merflo akis

Užapvalinti galiukai sumažina traumų tikimybę.

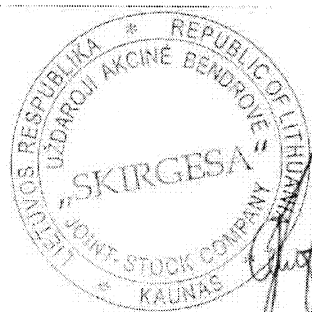


KOPIJA TIKRA

2018-04-09

Administratore
Gitarė Surošienė

Administratore
Gitarė Surošienė

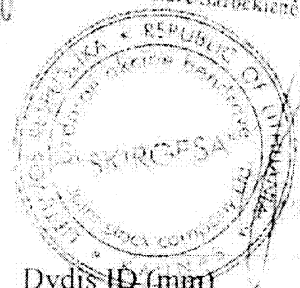



Kat. kodas	Dydis ID (mm)	Kat. kodas	Dydis ID (mm)
21120030	3.0	21120070	7.0
21120035	3.5	21120075	7.5
21120040	4.0	21120080	8.0
21120045	4.5	21120085	8.5
21120050	5.0	21120090	9.0
21120055	5.5	21120095	9.5
21120060	6.0	21120100	10.0
21120065	6.5		

A second generation SAD with an innovative Second Seal™


LMA Supreme™ is a second generation, gastric access device which forms an effective First Seal™ with the oropharynx (oropharyngeal seal) and an innovative Second Seal™ with the lower oesophageal sphincter (the oesophageal seal).

- ▶ Soft, elongated cuff designed to support an effective First Seal™ and Second Seal™^{2,3,4}
- ▶ Elliptical and anatomically shaped LMA Evolution Curve™ (airway tube) facilitates insertion success³
- ▶ Fixation tab and integral bite block²

no2 24 -
Lingvini laukė
apimantai
inhibicija

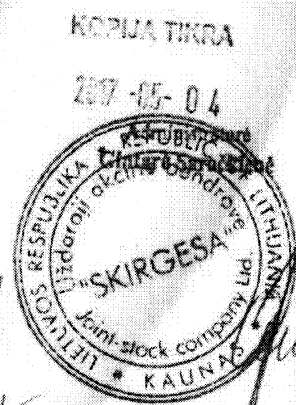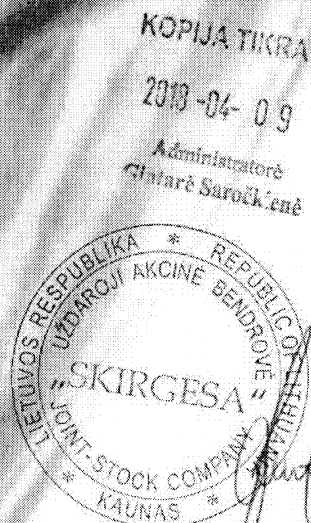

For the latest clinical evidence on LMA Supreme™ visit www.lmaco.com/evidence

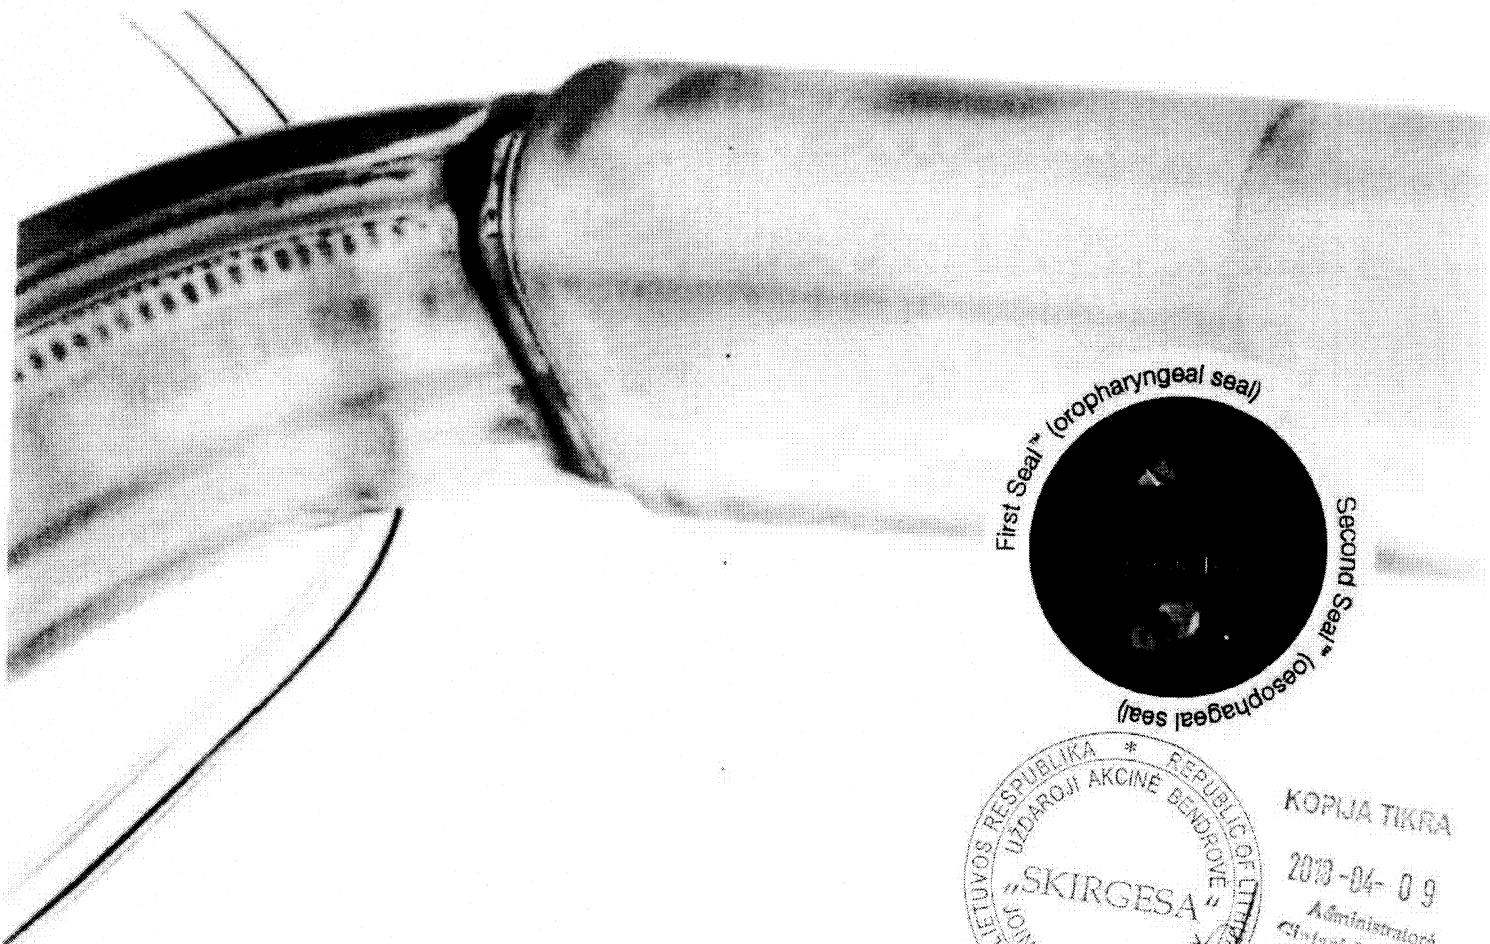

KOPIJA TIKRA
2010-04-09
Administratorė
Gintarė Saročkienė

First Seal™

LMA Supreme™ delivers measured oropharyngeal leak pressures up to 37 cm H₂O.⁵

The First Seal™ is important for:


- ▶ Ventilation performance
- ▶ Advanced uses of the device such as in patients with decreased thoracic compliance, in mild-to-moderately obese patients and in certain procedures requiring mechanical ventilation where higher seal pressures are required

Second Seal™

LMA Supreme™ enables passive drainage or active management of digestive tract contents independent of ventilation.⁴

The Second Seal™ is designed to:

- ▶ Improve safety vs a first generation device
- ▶ Secure the distal tip of the LMA Supreme™ at the upper oesophageal sphincter to maintain the patency of the drain tube
- ▶ Reduce the risk of insufflation during ventilation
- ▶ Reduce the risk of regurgitated gastric content leaking around the tip of the mask




KOPIJA TIKRA
2017-05-04
Administratorė
Gintarė Saročkienė
Administratorė
Gintarė Saročkienė

LMA Supreme™: Product specification

1	175010	Neonates/infants up to 5 kg	5 ml	6 Fr
1.5	175015	Infants 5-10 kg	8 ml	6 Fr
2	175020	Infants 10-20 kg	12 ml	10 Fr
2.5	175025	Children 20-30 kg	20 ml	10 Fr
3	175030	Children 30-50 kg	30 ml	14 Fr
4	175040	Adults 50-70 kg	45 ml	14 Fr
5	175050	Adults 70-100 kg	45 ml	14 Fr

⁵These are maximum volumes that should never be exceeded. It is recommended that the cuff be inflated to a maximum of 60 cm H₂O intracuff pressure.

OG = orogastric

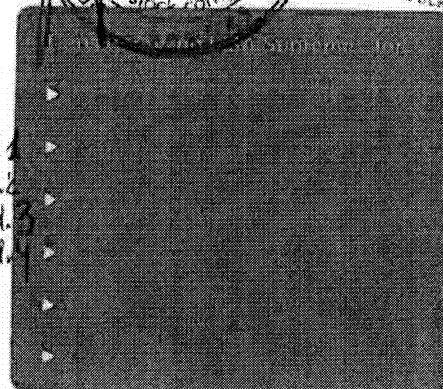

Antros kartos oro takų priemonė su inovatyvia antros angos technologija

LMA Supreme yra antros kartos, su skrandžio atsiurbimo kanalu, sukurta priemonė, kuri turi pirmąją orofaringinę angą bei antrąją angą - stemplės sfinkterio.

- Minkšta, prailginta pagalvėlė sukurta abiejų angų veiksmingumui.
- Elipsės forma ir anatomicinis išlenkimas, patogiam įvedimui
- Fiksavimo rankenėlė bei sukandimo blokatorius

Pirmoji anga

LMA Supreme sudaromas slėgis iki 37cm H₂O.

Pirma anga yra svarbi:

Ventiliacijai įprastu atveju ir kai pacientai turi viršsvorį ar tam tikrų procedūrų metu, kai reikalinga mechaninė ventiliacija ir didesnis slėgis reikalingas.

Antroji anga

LMA Supreme suteikia galimybę pasyviai atsiurbimui arba aktyviai virškinamo trakto stebėjimui, nepriklausomai nuo ventiliacijos.


Antroji anga:

Pagerintas saugumas, luginant su pirmos kartos priemonėm oro takams

Saugesnis distalinis galas, užtikrinantis atsiurbimo zondo praeinamumą

Sumažinta rizika įkvėpimui ventiliacijos metu

Sumažinta rizika nevalingo atpylimo skrandžio turiniu

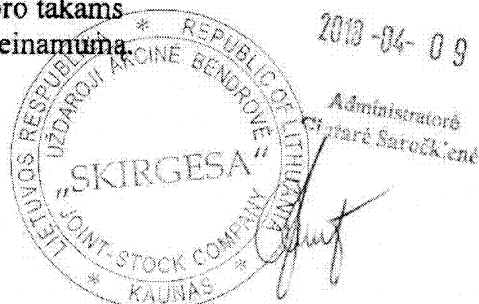

Dydis	Kodas	Paciento svoris	Pripūtimo tūris	Atsiurbimo zondo dydis
1	175010	Neonatalas/infantis iki 10-5 kg	5 ml	6 Fr
1.5	175015	Infantis 5-10 kg	8 ml	6 Fr
2	175020	Infantis 10-20 kg	12 ml	10 Fr
2.5	175025	Children 20-30 kg	20 ml	10 Fr
3	175030	Children 30-50 kg	30 ml	14 Fr
4	175040	Adults 50-70 kg	45 ml	14 Fr
5	175050	Adults 70-100 kg	45 ml	14 Fr

LMA Supreme rekomenduojama:

Pacientams, kuri turi vidutinį ar didelį viršsvorį


Pilvo srities operacijoms


Refliukso kontrolei

Pozityvaus slėgio ventiliacijai

Skubiai pagalbai

Plastinėms procedūroms

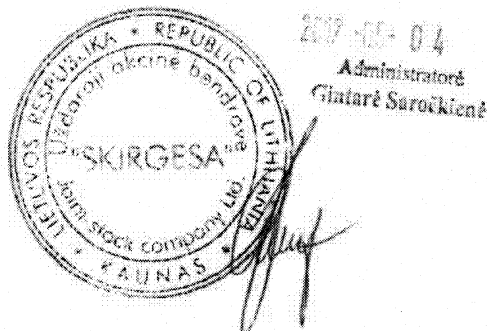



LMA Supreme™

Key features

Diagnostic test

Only way to guarantee gastric access.

Fixation tab

Facilitates optimal positioning within the oropharynx, hypopharynx and upper oesophagus to protect the integrity of the First Seal™ and Second Seal™.

Long connector

Designed to make connection with breathing tubes easy.

Narrow airway tube

Designed to make it easy to insert, especially in patients with small mouth opening.

Kink protection

Designed to protect against accidental kinking.

LMA Evolution Curve™

A more pliable airway tube facilitates greater anatomical compliance.

FIKSAVIMO
RAUKENĖLĖ


LENKTA
FORMA

KOPJA TIKRA

2010-04-09

Administratore

Gintarė Surockienė

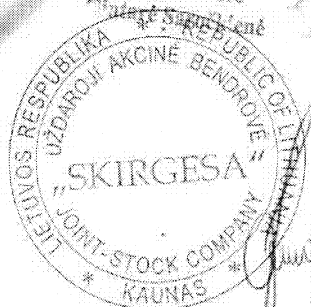

KOPJA TIKRA

2017-05-04

Administratore

Gintarė Surockienė



More features overleaf >

Teleflex

LMA Airform™ Cuff

Facilitates rapid insertion and optimum conformity to anatomy.

Second Seal™

Allows deeper protrusion to upper oesophageal sphincter than other second generation SADs. Can minimise gastric insufflation and reduce risk of aspiration.




Aperture fins and drain tube in the cuff bowl

Designed to protect against epiglottis down folding to secure the open airway.




Elongated cuff

Now a single piece with a curved back plate providing a smoother profile to aid insertion.




Smoother cuff material

Designed to reduce the likelihood of trauma to the upper oesophageal sphincter.



Streamlined cuff

Fluted, wedge-shaped tip designed to create a more streamlined profile for insertion.



Cuff tip angle

Allows the cuff to follow the contour of the upper oesophageal sphincter to optimise placement.



LMA Supreme™: The most advanced single use airway

1	175010	Neonates/infants up to 5 kg	5 ml
1.5	175015	Infants 5-10 kg	8 ml
2	175020	Infants 10-20 kg	12 ml
2.5	175025	Children 20-30 kg	20 ml
3	175030	Children 30-50 kg	30 ml
4	175040	Adults 50-70 kg	45 ml
5	175050	Adults 70-100 kg	45 ml

* These are maximum volumes that should never be exceeded. It is recommended that the cuff be inflated to a maximum of 60 cm H2O intracuff pressure.

6 Fr

6 Fr

10 Fr

10 Fr

10 Fr

10 Fr

10 Fr

10 Fr

10 Fr

10 Fr

10 Fr

10 Fr

10 Fr

10 Fr

10 Fr

10 Fr

10 Fr

10 Fr

10 Fr

10 Fr

10 Fr

10 Fr

10 Fr

10 Fr

10 Fr

10 Fr

10 Fr


10 Fr

10 Fr

Teleflex

Tubes/Respiration


Respiration Masks for single use

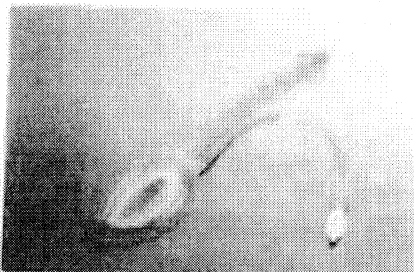

REF 44.000.60.010-050

Laryngeal Mask single-use, sterile With inflatable silicone cuff

Description	Pack	REF
Size 1	50	44.000.60.010
Size 1,5	50	44.000.60.015
Size 2	50	44.000.60.020
Size 2,5	50	44.000.60.025
Size 3	50	44.000.60.030
Size 4	50	44.000.60.040
Size 5	50	44.000.60.050

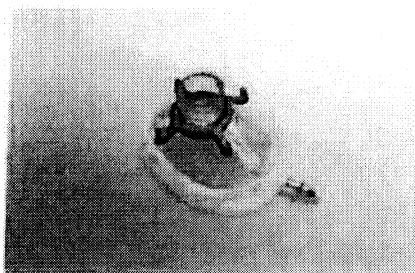

REF 51.480.00.000-006

Respiration Masks - single use With inflatable cuff

Description	Pack	REF
Size 0, neonatal	50	51.480.00.000
Size 1, infant	50	51.480.00.001
Size 2, pediatric	50	51.480.00.002
Size 3, adult, small	50	51.480.00.003
Size 4, adult, medium	50	51.480.00.004
Size 5, adult, large	50	51.480.00.005
Size 6, adult, extra large	50	51.480.00.006

26.8 psl

KOPIJA TIKRA

2013-04-09

Administratore
Gitarė Saročkaitė




REF 51.481.00.001-005


Respiration Masks - single use ECOPlus Open Cuff

Description	Pack	REF
Size 1	50	51.481.00.001
Size 2	50	51.481.00.002
Size 3	50	51.481.00.003
Size 4	50	51.481.00.004
Size 5	50	51.481.00.005

no 2.26
26.1
26.6

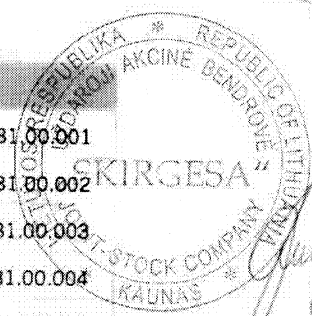

KOPIJA TIKRA



2013-04-04
Administratore
Gitarė Saročkaitė

SunMed

Laikiklis kontūrams

Be latekso, CE ženklintas

- Efektyviam vaikiškų ir suaugusiųjų pacientų kontūrų laikymui
- Galima pasirinkti iš nerūdijančio plieno ar plastikinių (PC) medžiagų
- PC modeliai yra tvirtesnis nei akriliniai ir lengvai valomi alkoholio tirpalais
- PC modeliai tinkami ir dujų vamzdeliams
- PC modeliai saugūs MR aplinkoje
- Matmenys 12.125"x5"x8,5"

• **MODELIAI**

KODAS	APRAŠYMAS	PAK
8-0038-01	Nerūdijančio plieno	1
8-0038-03	PC	1
8-0038-04	PC, universalus	1

KOPIJA TIKRA

2013-04-09

Administratorė
Gintarė Saročkienė



KOPIJA TIKRA

2013-05-04

Administratorė
Gintarė Saročkienė



002: 33

Easily operate one-lung ventilation by switch connector.

Cat.No.	Size(Fr)
23102800	28
23103200	32
23103500	35
23103700	37
23103900	39
23104100	41

Cat. No.	Size(Fr)
23202800	28
23203200	32
23203500	35
23203700	37
23203900	39
23204100	41

Fe
We
int
for

Well Lead Endobronchial Blocker Tube is designed to differentially intubate a patient's bronchus in order to isolate the left or right lung for procedures that require one-lung ventilation.

- 

-

- 

SIZE	tube length (mm)	cuff length (mm)	resting cuff diameter(mm)
9FR	695	18	15
7FR	695	16	12
5FR	640	10	8

Cat.No.

67400050

67100070

67100090

KOPJA TIKRA
2013-04-09

Administrators
Clare Savelle

